




CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

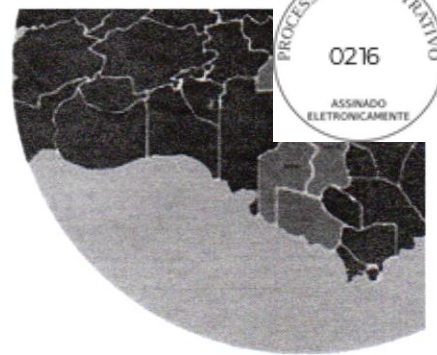

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000120250117000222

1. Descrição da Necessidade da Contratação

A contratação para aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para o Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Ticiano Van Den Brule Matos visa atender a uma necessidade essencial de saúde pública na Microrregião de Juazeiro do Norte. Esta necessidade é impulsionada pela demanda crescente por serviços odontológicos especializados, que são cruciais para a promoção da saúde bucal e para a prevenção de doenças mais graves.

O problema a ser resolvido é a insuficiência de recursos materiais para atender adequadamente à população que depende dos serviços prestados por este centro de especialidades odontológicas. A aquisição proposta garantirá a continuidade e a qualidade dos atendimentos, evitando desabastecimentos que possam comprometer o serviço. A medida faz parte de um planejamento estratégico que visa otimizar o uso dos recursos disponíveis de forma econômica e eficiente, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021.

Considerando o interesse público, a aquisição destes insumos é fundamental para assegurar um atendimento digno e eficaz aos pacientes, minimizando os impactos de patologias bucais na saúde geral da população atendida. Além disso, reforça a capacidade do consórcio de atuar como referência regional em saúde odontológica, com benefício direto para o bem-estar coletivo e a saúde pública da região.

2. Área requisitante

Área requisitante

Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Juazeiro do Norte

Responsável


Esther Viana de Oliveira

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

A descrição dos requisitos da contratação visa estabelecer os critérios necessários e suficientes para a escolha da solução mais adequada, conforme os padrões de



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

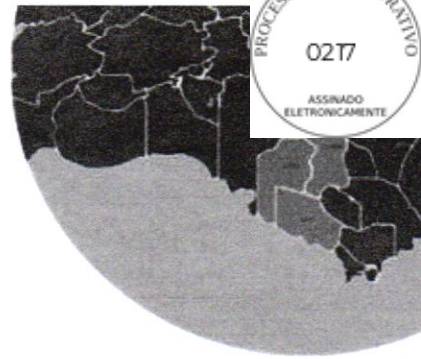

sustentabilidade, qualidade e desempenho exigidos por regulamentações específicas. Essa abordagem assegura o alinhamento da compra com as melhores práticas de mercado e princípios legais, contribuindo para a realização de um processo licitatório competitivo e bem-sucedido.

- **Requisitos Gerais:**
 - Os materiais e equipamentos odontológicos devem ser compatíveis com as necessidades operacionais do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Ticiano Van Den Brule Matos.
 - Os itens fornecidos devem possuir garantia mínima de funcionamento e entregas dentro dos prazos estabelecidos.
- **Requisitos Legais:**
 - Conformidade com as normas da ANVISA e registro ou cadastro obrigatório para os equipamentos.
 - Atendimento às especificações da ABNT pertinentes aos produtos odontológicos.
- **Requisitos de Sustentabilidade:**
 - Preferência por materiais e equipamentos com certificação ambiental ou que demonstrem práticas sustentáveis de fabricação e logística reversa.
 - Prioridade para fornecedores que adotem práticas de baixo consumo de recursos em seus processos produtivos.
- **Requisitos da Contratação:**
 - Fornecimento contínuo de materiais de consumo odontológico, prevenindo desabastecimento.
 - Suporte técnico e assistência para qualquer equipamento adquirido ao longo do prazo de contrato.
 - Manutenção preventiva inclusa para todos os equipamentos de grande porte, como autoclaves e cadeiras odontológicas.

Os requisitos especificados são necessários para garantir a adequação da contratação à necessidade de atendimento odontológico especializado no Centro. A listagem foi cuidadosamente delineada para incluir apenas aspectos essenciais, evitando exigências desnecessárias que poderiam comprometer o caráter competitivo do processo licitatório.

4. Levantamento de mercado

O levantamento de mercado para a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos abrangeu um estudo detalhado das soluções de contratação disponíveis no mercado. A seguir, apresentamos as principais opções identificadas:


- Contratação direta com fornecedores especializados em materiais e equipamentos odontológicos.
- Contratação através de sistemas de registro de preços, potencializando a economia de escala.

Enun
Q
+



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

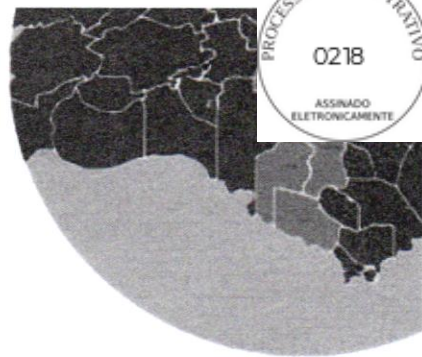

- Aquisição por meio de consórcios de saúde, unindo demandas de diferentes instituições para negociar melhores condições.
- Parcerias com grandes distribuidores para garantir fornecimento contínuo e condições comerciais vantajosas.
- Participação em licitações eletrônicas para maximizar a concorrência e garantir transparência no processo de contratação.

Com base na análise das soluções acima mencionadas, a adoção do sistema de registro de preços se apresenta como a solução mais adequada para esta contratação. Esta modalidade é preferível devido aos seguintes fatores:

- Possibilidade de assegurar preços mais competitivos mediante a economia de escala.
- Facilidade em atualizar os preços registrados de acordo com as condições de mercado, garantindo sempre o melhor custo-benefício.
- Flexibilidade para atender às variações na demanda ao longo do exercício de 2025 sem a necessidade de novos procedimentos licitatórios.
- Aumento da competitividade e participação de fornecedores, promovendo maior diversidade de opções e inovação.

Com essas considerações, a contratação através do sistema de registro de preços será capaz de atender de forma efetiva e eficiente às necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Ticiano Van Den Brule Matos, garantindo a qualidade e continuidade dos serviços prestados à população da Microrregião de Juazeiro do Norte.

5. Descrição da solução como um todo

A presente solução contempla a contratação de materiais e equipamentos odontológicos para o Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Ticiano Van Den Brule Matos, conforme a previsão necessária para o ano de 2025. O objetivo é garantir a continuidade e a qualidade dos serviços odontológicos especializados prestados à população da Microrregião de Juazeiro do Norte. Este ETP adota como fundamentação legal a Lei 14.133/2021, que disciplina as licitações e contratos administrativos no âmbito das administrações públicas.

O processo de registro de preços foi escolhido como a modalidade mais adequada devido à necessidade de aquisição contínua e escalonada de itens ao longo do tempo, maximizando a economicidade e eficiência da contratação, conforme preconizam os princípios da nova legislação. A escolha da modalidade pregão eletrônico também reitera o compromisso com princípios de transparência e competitividade, sendo amplamente reconhecida por sua eficácia e economia.

O mercado apresenta várias alternativas de fornecedores para os itens requeridos, todos em conformidade com as normas da ANVISA e da ABNT. Os materiais de consumo e equipamentos odontológicos listados são essenciais para o funcionamento



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



adequado do centro, alinhados às melhores práticas de saúde e segurança vigentes no Brasil.

Portanto, a solução apresentada, mediante registro de preços, é a mais adequada à necessidade pública, visando garantir a melhor relação custo-benefício, com flexibilidade e controle sobre os estoques, além de assegurar atendimento ininterrupto e qualificado à população local.


6. Estimativa das quantidades a serem contratadas

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
1	ABAIXADOR LÍNGUA	12,000	PACOTE 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: MADEIRA TIPO: DESCARTÁVEL COMPRIMENTO: 14 CM FORMATO: TIPO ESPÁTULA LARGURA: 1,50 CM ESPESSURA: 2 MM			
2	AGULHA ODONTOLÓGICA	60,000	CAIXA 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA DIMENSÃO: 30 G CURTA TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE			
3	AGULHA ODONTOLÓGICA	6,000	CAIXA 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA DIMENSÃO: 27 G LONGA TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE			
4	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5%	5,000	FRASCO 1 LITRO
Especificação: EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMBALAGEM CONTENDO 1L. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
5	ÁLCOOL ETÍLICO 70%	6,000	BOBONA 5 LITROS
Especificação: EM GEL HIGIENIZANTE ANTISSEPTICO HIDRATANTE PARA AS MÃOS, SECA INSTANTANEMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 5L. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
6	ÁLCOOL ETÍLICO 70%	150,000	FRASCO 1 LITRO
Especificação: EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM CONTENDO 1L. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
7	ALGODÃO	120,000	PACOTE 100 UNIDADE
Especificação: TIPO: HIDRÓFILO APRESENTAÇÃO: EM ROLETE MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS PESO: 25 G			
8	ALGODÃO HIDRÓFILO	6,000	PACOTE 500 GRAMAS



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

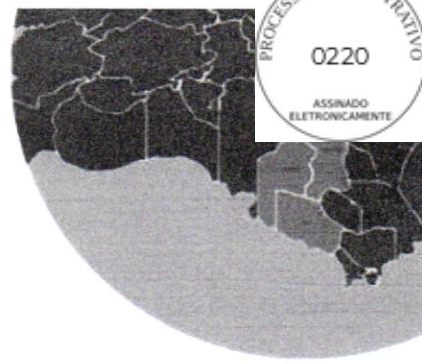


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: EM MANTA FINA DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBRE POSTAS, REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PESO: 500G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA			
9	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%	100,000	Caixa
Especificação: COM VASOCONSTRICTOR DE EPINEFRINA 1:100.000. ACONDICIONADO EM TUBETE DE VDRO. EMBALAGEM COM 50 TUBETES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA			
10	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3%	2,000	Caixa
Especificação: SEM VASOCONSTRICTOR - EM TUBETES 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES. USO INJETÁVEL. CARPULE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
11	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA	2,000	Caixa
Especificação: COM FENILEFRINA ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL Á BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA COM TUBETES EM VIDRO 1.100.000 PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA LISTA DE ENTREGA			
12	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA HCL 2%	190,000	Caixa
Especificação: COM VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA -1:100.000 COM TUBETES EM VIDRO 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES. USO INJETÁVEL. CARPULE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
13	BENZOCAÍNA	10,000	POTE 12 GRAMA
Especificação: CONCENTRAÇÃO: 20% USO: GEL TÓPICO			
14	ANTISSÉPTICO BUCAL	12,000	Litro
Especificação: GLUCONATO DE CLOREXIDINA - COM CONCENTRACAO DE 0,12 PORCENTO + 0,5 POR CENTO FLUORETO DE SODIO; UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECCAO CARIOGENICA, GENGIVITE; SOLUCAO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR VARIADO. EMBALAGEM COM 1 LITRO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA			
15	APLICADOR ODONTOLÓGICO	10,000	PACOTE 100 UNIDADE
Especificação: TIPO HASTE: DOBRÁVEL TIPO USO: DESCARTÁVEL APLICAÇÃO: ADESIVOS DENTINÁRIOS, MAT. LIQ. OU DE BAIXA VISC.			
16	AVENTAL HOSPITALAR	500,000	Unidade
Especificação: MATERIAL*: POLIPROPILENO GRAMATURA: CERCA DE 40 G/CM2 COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, Resistente à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias. ESTERILIDADE*: USO ÚNICO			
17	BICARBONATO DE SÓDIO	2,000	Frasco
Especificação: INDICADO PARA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO DE PLACAS BACTERIANAS, DEVIDO SEU ALTO GRAU DE PUREZA E POR POSSUIR GRANULAÇÃO EXTRAFINA, PROPORCIONA JATEAMENTO AMPLO, LIVRE E CONTÍNUO. USADO COMO UM ABRASIVO DE ALTA PUREZA. GRANULOMETRIA SUPERFINA. VALIDADE: 2 ANOS. EMBALAGEM COM 250G.			
18	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO	2,000	Unidade
Especificação: TIPO: CIMENTAÇÃO ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO			
19	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO	195,000	Unidade
Especificação: TIPO: RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO			

small
@
f



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

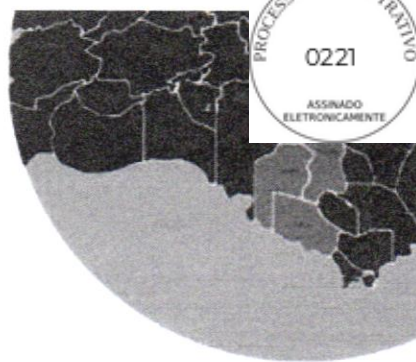

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
20	CUNHA ODONTOLÓGICA	1,000	CAIXA 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: MADEIRA TIPO: ANATÔMICA APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL TIPO PONTA: FINA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS			
21	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO	2,000	SERINGA 3 MILILITRO
Especificação: COMPOSIÇÃO BÁSICA: OXALATO DE POTÁSSIO CONCENTRAÇÃO: 3% ASPECTO FÍSICO*: GEL			
22	FILME RADIOLÓGICO	2,000	CAIXA 150 UNIDADE
Especificação: TIPO: ODONTOLÓGICO DIMENSÕES: 30 X 40 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Modelo Adulto			
23	FIO DENTAL	15,000	Frasco
Especificação: ENCERADO, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 METROS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
24	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA	2,000	Rolo
Especificação: INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COM RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL. DISPOSITIVO MECÂNICO COM A FINALIDADE DE CONFERIR AO MATERIAL RESTAURADOR A ANATOMIA NATURAL DO DENTE, ALÉM DE PROTEGER DOS DENTES ADJACENTES DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE PREPARO, CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DO ADESIVO. APRESENTADO EM BOBINA, PODE SER CORTADO NO TAMANHO DESEJADO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL MALLEÁVEL; ESPESSURA DE 0,05MM; FITA MATRIZ DE AÇO DE 0,05MM X 7 MM. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
25	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA	2,000	Rolo
Especificação: INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COM RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL. DISPOSITIVO MECÂNICO COM A FINALIDADE DE CONFERIR AO MATERIAL RESTAURADOR A ANATOMIA NATURAL DO DENTE, ALÉM DE PROTEGER DOS DENTES ADJACENTES DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE PREPARO, CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DO ADESIVO. APRESENTADO EM BOBINA, PODE SER CORTADO NO TAMANHO DESEJADO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL MALLEÁVEL; ESPESSURA DE 0,05MM; FITA MATRIZ DE AÇO DE 0,05MM X 5 MM. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
26	FIXADOR RADIOLÓGICO	2,000	FRASCO 475 MILILITRO
Especificação: APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO			
27	FLUORETO DE SÓDIO	6,000	FRASCO 200 MILILITRO
Especificação: CONCENTRAÇÃO: 1,23% FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ACIDULADO			
28	GÁS BUTANO REFINADO	60,000	Frasco
Especificação: GÁS BUTANO DESTILADO E DESODORIZADO COM VÁLVULA PARA ISQUEIROS E MAÇARICOS, CONTENDO 300 ML EM VASILHAME DE 254 G COM BICOS ADAPTADORES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
29	MAÇARICO PORTÁTIL	10,000	Unidade
Especificação: O Maçarico Portátil Recarregável é prático e versátil, ideal para uso culinário e outras aplicações. Possui tanque para gás butano, ajuste de chama preciso e trava de segurança, proporcionando eficiência e segurança no manuseio. *Utiliza refil para isqueiro com gás butano. Gás butano não incluso. Tamanho: 10,0x11,0x2,5cm			
30	COMPRESSA GAZE	130,000	PACOTE 500 UNIDADE

20mlh
@
+

Avenida Leão Sampaio, s/n CEP: 63.180-000 Barbalha - CE

Telefone: (88) 3532-3386

cpsmjuaizerodonorte.ce.gov.br

@cpsm.jn


SESA



**SECRETARIA
DA SAÚDE**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

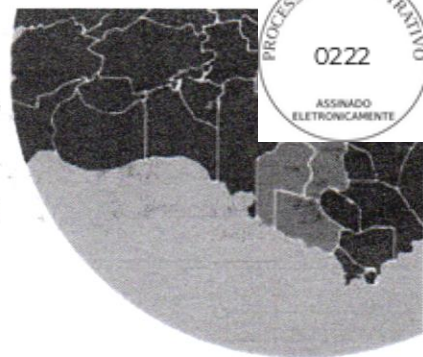


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: MATERIAL: 100% ALGODÃO DIMENSÕES: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM GRAMATURA: 9 FIOS/ CM2 ADICIONAL: 5 DOBRAS			
31	GORRO HOSPITALAR	60,000	EMBALAGEM 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO MODELO: ELÁSTICO NUCA COR*: SEM COR GRAMATURA*: CERCA DE 30 G/M2 TAMANHO: ÚNICO TIPO USO: DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX			
32	LÂMINA BISTURI	6,000	CAIXA 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO: Nº 15 TIPO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AFIADA E POLIDA, Embalada em papel aluminizado, que preserva a esterilidade até o momento do uso.			
33	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº15C	6,000	CAIXA COM 100 UNIDADES
Especificação: EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LAMINA. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE ENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
34	ÓLEO LUBRIFICANTE.	36,000	FRASCO 200 MILILITRO
Especificação: APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO ORIGEM: MINERAL USO: CANETA ODONTOLÓGICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDUÇÃO DE ATRITO NA MONTAGEM DA TURBINA E ROLAMEN APLICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS,			
35	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	100,000	CAIXA 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: EXTRAPEQUENO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA COR: BRANCA TIPO: AMBIDESTRA			
36	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	75,000	CAIXA 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: GRANDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA COR: BRANCA. EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE.			
37	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	150,000	CAIXA 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: MÉDIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL TIPO USO: DESCARTÁVEL			
38	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	200,000	CAIXA 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: PEQUENO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA COR: BRANCA. EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE.			
39	LUVA CIRÚRGICA	500,000	Par
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: 7 ESTERILIDADE: ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ, BIOABSORVÍVEL E ANTIDERRAPANTE COR: BRANCA LEITOSA TIPO USO: DESCARTÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESPESSURA: 0,19 A 23 MM. EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE			
40	LUVA CIRÚRGICA	500,000	Par
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: 7,50 ESTERILIDADE: ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ, BIOABSORVÍVEL E ANTIDERRAPANTE COR: BRANCA LEITOSA TIPO USO: DESCARTÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESPESSURA: 0,19 A 23 MM. EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE.			

saub
@
f



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

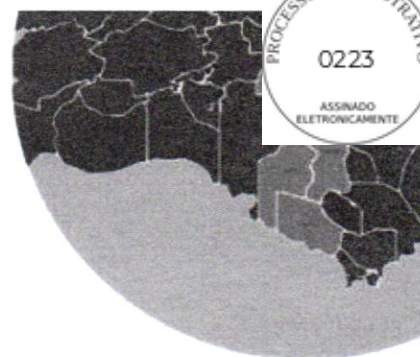

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
41	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA PROTEÇÃO	150,000	Caixa

Especificação: ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 50 UN. COM ELÁSTICO; TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS SUPER-RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO; CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO; DESCARTÁVEL; COR BRANCA; EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

42	MÁSCARA N95	30,000	Unidade
----	-------------	--------	---------

Especificação: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FORMATO BICO DE PATO, DESENVOLVIDA PARA PROTEGER OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICAS/ PATOLÓGICAS OU EM OUTRAS SITUAÇÕES EM QUE HAJA A EMISSÃO DE PARTÍCULAS OU VAPORES NOCIVOS. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: NÃO ESTÉRIL, POSSUI 6 CAMADAS, SENDO: DUAS CAMADAS DE MELTBONDED (FILTRO PROTETOR); 1 CAMADA EXTERNA DE SPUNBONDED AZUL (ESTÉTICA); 1 CAMADA INTERNA DE SPUNBONDED BRANCO (CONFORTO); 1 CAMADA INTERMEDIÁRIA DE SPUNBONDED (SEPARADOR DOS FILTROS) E 1 CAMADA INTERMEDIÁRIA DE FELTRO (SUSTENTAÇÃO), DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE. EMBALAGEM. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO.

43	PASTA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS	6,000	Unidade
----	---	-------	---------

Especificação: ESPECIFICAÇÃO: EM SERINGA COM APROX. 4G; CONTENDO UMA PASTA DE UMA PASTA DE GRANULACAO FINA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA

44	PASTA PROFILÁTICA	12,000	BISNAGA 90 GRAMA
----	-------------------	--------	------------------

Especificação: COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR

45	PEDRA - POMES	2,000	FRASCO 100 GRAMA
----	---------------	-------	------------------

Especificação: MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA COR: BRANCA ASPECTO FÍSICO: PÓ APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL USO: ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO

46	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES	2,000	Seringa
----	---------------------------------------	-------	---------

Especificação: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A1; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO.; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR DA DATA DE ENTREGA.

47	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES	4,000	Seringa
----	---------------------------------------	-------	---------

Especificação: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A2; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO.; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR DA DATA DE ENTREGA.

48	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES	4,000	Seringa
----	---------------------------------------	-------	---------


Especificação: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO.; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR DA DATA DE ENTREGA.

49	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES	2,000	Seringa
----	---------------------------------------	-------	---------

emulh
@
J



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

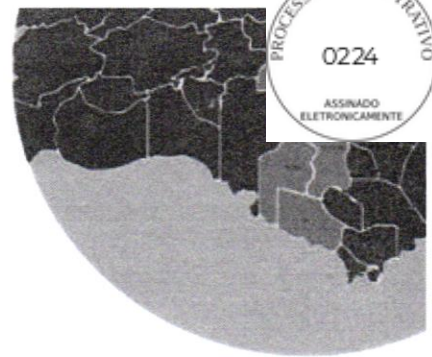


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES- FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3, 5; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO.; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
50	REVELADOR RADIOLÓGICO	2,000	FRASCO 475 MILILITRO
Especificação: TIPO: SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL			
51	SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL	4,000	Kit
Especificação: KIT COM SELANTE 5 ML, ÁCIDO 5ML, BISFENOL A GLICIDILMETACRILATO (35,60%); GRUPOS DIMETACRILATOS; B.H.T.;DIÓXIDO DE SILÍCIO; FLUORETO DE SÓDIO E CATALISADOR.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
52	SERINGA DESCARTÁVEL (5ML) SEM AGULHA	50,000	Caixa
Especificação: É UTILIZADA PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES, INTRADÉRMICAS E INTRAVENOSAS NO QUE DIZ RESPEITO À: COLETA DE SANGUE, INJEÇÃO DE SOLUÇÕES MEDICAMENTOSAS, ASPIRAR FLUIDOS CORPÓREOS ENTRE OUTROS; CILINDRO TRANSLÚCIDO EM POLIPROPILENO; ÊMBOLO EM POLIPROPILENO DE GRAU MÉDICO; AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL (304 OU ISO 7153-1); RETENTOR HERMÉTICO, QUE GARANTE SUAVE DESLIZAMENTO DENTRO DO CILINDRO; CONECTOR TIPO LUER LOCK (CENTRAL); ESCALA VOLUMÉTRICA DEMARCADA EM MILILITROS, DE FÁCIL LEITURA E DOSAGEM EXATA DAS SOLUÇÕES; AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL QUE PERMITE ACESSO INTRAVASCULAR E INTRAMUSCULAR NA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, EXTRAÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS; CÂNULAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA;TAMPA PROTETORA DA CÂNULA EM POLIPROPILENO. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
53	HEMOSTÁTICO TÓPICO	2,000	FRASCO 10 MILILITRO
Especificação: PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO			
54	SUGADOR	150,000	Pacote
Especificação: MATERIAL: PVC TIPO: SALIVA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ ARAME APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL			
55	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	1,000	Unidade
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM LARGURA: 4 MM APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL			
56	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	1,000	Unidade
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM LARGURA: 6 MM APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL			
57	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	1,000	EMBALAGEM 150 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO COMPRIMENTO: CERCA DE 170 MM LARGURA: CERCA DE 4 MM TIPO USO: DESCARTÁVEL			
58	TIRA DE POLIESTER USO ODONTO	1,000	Pacote
Especificação: ESPECIFICAÇÃO: PARA AUXILIAR NA CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS; MEDIDA C.120MM (100 A 140 MM); L(9,5 A 11MM); ESP.0,05MM; CX C/ 50 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
59	VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE	1,000	Kit

mult @




CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

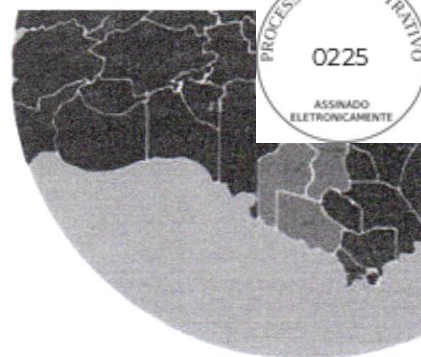


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: PARA PREVENÇÃO DA RECIDIVA E OCORRÊNCIA DE CÁRIES E FLUORETAÇÃO DO ESMALTE. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6% ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. E ETANOL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DEVERNIZ COM 10 ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10 ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA			
60	CIMENTO ODONTOLÓGICO	2,000	Unidade
Especificação: TIPO: CIRÚRGICO PERIODONTAL CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM EUGENOL ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO			
61	ESCOVA DEGERMAÇÃO	200,000	Unidade
Especificação: APLICAÇÃO: COM PVP À 10% IODADO À 1%, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE COMPONENTES: C/ LIMPADOR DE UNHAS, BASE QUE PERMITA MANUSEIO A-			
62	ESPONJA COM AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTO	6,000	Caixa
Especificação: COMPOSTO DE COLAGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRAGIAS, CAPILARES, POS OPERATORIO; AGENTE HEMOSTÁTICO COLAGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CUBICA, ESTERILIZADO POR OXÍDIO DE ETILENO, HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. C/ 10 UNID			
63	FITA PARA GLICOSÍMETRO	1,000	Caixa
Especificação: ESPECIFICAÇÃO: FITA PARA GLICEMIA - COPATÍVEL COM APARELHO DA MARCA GLICOSÍMETRO (EM COMODATO) SENDO O APARELHO COM 99% DE PRECISÃO, SIMPLES DE SE UTILIZAR, BASTA APENAS DUAS ETAPAS, TRAZ RESULTADOS RÁPIDOS PARA O USUÁRIO EM 10 SEGUNDOS. APRESENTAÇÃO: UM MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, CHIP DE CODIFICAÇÃO, SOLUÇÃO CONTROLE, LANCETAS ESTÉREIS, ESTOJO, DISPOSITIVO PARA LANCETAS, MANUAL DE INSTRUÇÃO. CAIXA C/100. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
64	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO 3-0	48,000	Caixa
Especificação: DE NYLON TRANCADA; COM DIÂMETRO 03- 0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NÃO ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
65	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO 4-0	30,000	Caixa
Especificação: DE NYLON TRANCADA; COM DIÂMETRO 04- 0, 45 CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NÃO ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
66	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 4-0	5,000	Caixa
Especificação: A SUTURA DE CATEGUTÉ CROMADO - FIO DE SUTURA É DO TIPO ABSORVÍVEL, DE ORIGEM ANIMAL, ESTÉRIL, COMPOSTA POR TECIDO CONECTIVO PURIFICADO, PRINCIPALMENTE COLÁGENO. DIÂM. FIO: 4-0; COMP. FIO: 75CM; TAM. AG.: 2,0CM; DESC. AG.: 1/2 CÍRCULO; COR: MARROM; CAIXA COM 24 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
67	FORMALDEÍDO (FORMOL)	2,000	Litro
Especificação: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO CONCENTRAÇÃO: À 10% CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EM SOLUÇÃO AQUOSA TAMPONADA			
68	KIT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	2.000,000	Kit
Especificação: KIT DE CIRURGIA DESCARTÁVEL ESTÉRIL CONTENDO: 02 TOALHAS DE MÃO; 02 GORROS DE LAÇO; 02 TOUCAS SANFONADAS; 02 AVENTAIS CIRÚRGICOS M/L; 03 MÁSCARAS TRIPLAS COM ELÁSTICO; 02 CAMPOS DE MESA 0,70 X 0,90M; 02 PROTETORES DE REFLETOR PP; 02 PROTETORES DE SUGADOR E MANGUEIRA 1,20 X 0,80M; 01 CAMPO CIRÚRGICO 02, 00 X 0,90. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO DA DATA DE ENTREGA.			
69	SORO FISIOLÓGICO 0.9% ESTÉRIL	250,000	Frasco
Especificação: CLORETO DE SÓDIO DE 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 100 ML. SISTEMA FECHADO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			

Em anexo
@
J



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

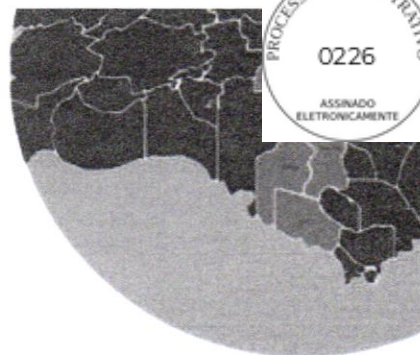

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
70	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 2%	6,000	Litro

Especificação: ANTISSEPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ- OPERATÓRIO. O DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA É UM ANTISSEPTICO QUÍMICO, COM AÇÃO ANTIFÚNGICA E BACTERICIDA, CAPAZ DE ELIMINAR TANTO BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS QUANTO GRAM- NEGATIVAS. POSSUI TAMBÉM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO BACTERIANA. É GERALMENTE UTILIZADO NA LIMPEZA DA PELE EM PRÉ- OPERATÓRIOS E TAMBÉM EM ALGUNS PEQUENOS PROCEDIMENTOS INVASIVOS COMO SUBSTITUTO A SOLUÇÕES CONTENDO IODO.

71	SUGADOR CIRÚGICO	48,000	Caixa
----	------------------	--------	-------

Especificação: PARA SANGUE, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 40 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA ENTREGA.

72	ALGINATO CROMÁTICO TIPO I	250,000	Pacote
----	---------------------------	---------	--------

Especificação: PARA IMPRESSÃO, DE BAIXA SINÉRESE, COM CLOREXIDINA E LIVRE DE POEIRA, COM CARACTERÍSTICAS DE MUDAR DE COR DUAS VEZES, IDENTIFICANDO PRESA TOTAL E MOMENTO IDEAL PARA VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA ENTREGA.

73	CERA ODONTOLÓGICA	18,000	Unidade
----	-------------------	--------	---------

Especificação: TIPO: 7 APRESENTAÇÃO: CAIXA 18 LÂMINAS PESO: CERCA DE 220 G COR: VERMELHA/ROSA

74	CERA ODONTOLÓGICA	10,000	Unidade
----	-------------------	--------	---------

Especificação: TIPO: 9 APRESENTAÇÃO: CAIXA 18 LÂMINAS PESO: CERCA DE 220 G COR: VERMELHA/ROSA

75	CERA ODONTOLÓGICA	150,000	Unidade
----	-------------------	---------	---------

Especificação: TIPO: PERIFÉRICA APRESENTAÇÃO: CAIXA 40 BASTÕES PESO: CERCA DE 45 G COR: VERMELHA/ROSA

76	CERA ODONTOLÓGICA	6,000	Unidade
----	-------------------	-------	---------

Especificação: TIPO: UTILIDADE APRESENTAÇÃO: CAIXA 5 LÂMINAS PESO: CERCA DE 220 G COR: VERMELHA/BRANCA

77	CONDICIONADOR DE TECIDOS PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS MACIA	1,000	Kit
----	---	-------	-----

Especificação: KIT COM PÓ 170G E LÍQUIDO 177 ML. NA COR ROSA DE GENGIVA ARTIFICIAL. PODE SER PRENSADO NA CONFEÇÃO DA PRÓTESE. PODE SER REEMBASADO NA BOCA. PRECAUÇÕES: SOMENTE PARA USO - MACIO. REEMBASAMENTO DE PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS. CONFEÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL NOS MODELOS. PODE SER PRENSADO NA CONFEÇÃO DA PRÓTESE. PODE SER REEMBASADO NA BOCA. PRECAUÇÕES: SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO; LÍQUIDO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO: PÓ: POLÍMERO ACRÍLICO DE ETILMETACRILATO. LÍQUIDO: MONÔMERO ACRÍLICO ETILMETACRILATO, ÁLCOOL DESNATURADO E PLASTIFICANTE FTÁLICO. GLAZE: METILMETACRILATO E POLIMETILMETACRILATO. APRESENTAÇÃO: CADA KIT TEM: 1 FRASCO DE 40GR; 1 FRASCO DE 40 ML; 1 GLAZE 8 ML; 2 COPOS MEDIDORES; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

78	DISSOLVENTE DE GESSO	4,000	Frasco
----	----------------------	-------	--------

Especificação: SOLVENTE DE GESSO DE 1 LITRO - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA ENTREGA.

79	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO USO ODONTOLÓGICO	5,000	Frasco
----	---	-------	--------

Especificação: APRESENTAÇÃO DE DUPLA COR COM 280 TIRAS DE 76X22MM E ESPESSURA DE 19 MICROMETROS; COMPOSTO POR PAPEIS ESPECIAIS, CERAS E ÓLEOS VEGETAIS, PIGMENTOS, PARAFINA E VASELINA. INDICADO PARA MARCAR CONTATOS OCLUSAIS. . PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

80	FIXADOR PARA PRÓTESE DENTÁRIA	12,000	Tubo
----	-------------------------------	--------	------


Especificação: SEM SABOR, EM CREME, SAL PARCIAL MISTO DE SÓDIO/CÁLCIO DE POLI (METILVINILÉTER/ÁCIDO MALEICO), CARBOXIMETILCELULOSE, ÓLEO MINERAL, VASELINA.- TUBO 8,5G- QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ULTRA COREGA .PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

81	RESINA ACRÍLICA PÓ	2,000	Frasco
----	--------------------	-------	--------

anexo
②
✍



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

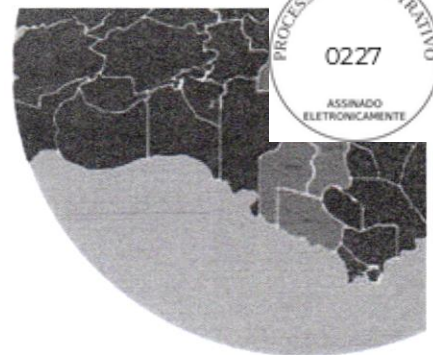


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: INDICADO PARA REEMBASAMENTO, CONFEÇÃO COROAS CÔNICAS E TELESCÓPICAS; PRÓVISÓRIOS; INCRUSTAÇÕES, BARRAS LINGUAIS E PALATAIS; CONECTORES DE GRAMPOS; PONTES ADESIVAS; ALINHAMENTO DE JUNTAS A SEREM SOLDADAS; CONECTAR JUNTAS NO ENCERAMENTO DE PONTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM: PÓ COM 78G. INCOLOR.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA ENTREGA.			
82	RESINA ACRÍLICA LÍQUIDA	2,000	Frasco
Especificação: AUTOPOLIMERIZÁVEL, PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO; EMBALAGEM: 120 ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA ENTREGA.			
83	GESSO - USO ODONTOLÓGICO	200,000	EMBALAGEM 1 QUILOGRAMA
Especificação: TIPO: COMUM TIPO II			
84	GESSO - USO ODONTOLÓGICO	300,000	EMBALAGEM 1 QUILOGRAMA
Especificação: TIPO: PEDRA ESPECIAL TIPO IV			
85	PASTA MOLDAGEM	90,000	Unidade
Especificação: MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL TIPO: BASE + CATALISADOR APRESENTAÇÃO *: CONJUNTO COMPLETO QUALIADE IGUAL OU SUPERIOR À LYSANDA			
86	LÁPIS COPIA ESPECIAL PARA GESSO	1,000	Caixa
Especificação: LÁPIS PARA DELIMITAÇÃO DO MODELO. ESPECIAL PARA TRABALHOS EM GESSO. CONTEÚDO: CAIXA COM 12 LÁPIS. LÁPIS CÓPIA NA COR AZUL. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DADATA DE ENTREGA.			
87	VASELINA SÓLIDA	3,000	Frasco
Especificação: INDICAÇÕES: USO COMO EMOLIENTE.MODO DE USAR:USO TÓPICO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 90G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
88	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO	5,000	Unidade
Especificação: APLICAÇÃO: P/ ALGINATO TIPO: DOSADOR P/ PÓ MATERIAL: PLÁSTICO TIPO USO: REUTILIZÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORRESPONDENTE A MARCA DE ALGINATO ENTREGUE			
89	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	2,000	PACOTE 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: LÁTEX NATURAL TIPO: EXTRAORAL DIÂMETRO: 1/2 POL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL TIPO FORÇA: FORÇA PESADA			
90	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	2,000	PACOTE 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: LÁTEX NATURAL TIPO: EXTRAORAL DIÂMETRO: 1/2 POL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL TIPO FORÇA: FORÇA MÉDIA			
91	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	2,000	PACOTE 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: LÁTEX NATURAL TIPO: EXTRAORAL DIÂMETRO: 1/2 POL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL TIPO FORÇA: FORÇA LEVE			
92	GESSO BRANCO ORTODÔNTICO	50,000	Pacote
Especificação: É UM GESSO ALFA SUPER ALVO ESPECIAL PARA USO EM ORTODONTIA PELA EXCELENTE RESISTÊNCIA À FISSURA. SUA GRANULOMETRIA É FINA COM ACABAMENTO DE ALTO BRILHO. EMBALAGEM: PACOTE COM 2KG. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
93	EMBALAGEM ORTODONTIA	500,000	INIDADE
Especificação: MATERIAL: PLÁSTICO TIPO: CAIXA P/ APARELHO COM TAMPA E ALÇA			



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

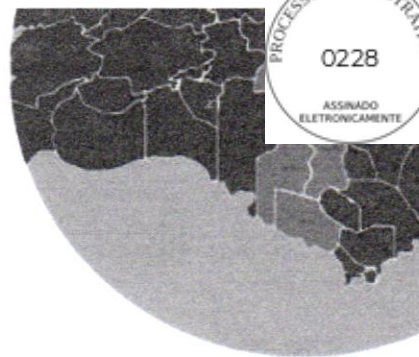

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
94	ARCO EXTRAORAL MÉDIO DURO PEQUENO 51	2,000	Unidade

Especificação: INDICADO JUNTAMENTE COM VÁRIOS TIPOS DE CASQUETES E TALAS CERVICAIS PARA A OBTENÇÃO DE FORÇAS ORTODÔNTICAS OU ORTOPÉDICAS. OS ARCOS EXTRAORAIS SÃO CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL ESPECIAL, COM ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. VERSATILIDADE NO ÂNGULO DA APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

95	ARCO EXTRAORAL MÉDIO 50	2,000	Unidade
----	-------------------------	-------	---------

Especificação: INDICADO JUNTAMENTE COM VÁRIOS TIPOS DE CASQUETES E TALAS CERVICAIS PARA A OBTENÇÃO DE FORÇAS ORTODÔNTICAS OU ORTOPÉDICAS. OS ARCOS EXTRAORAIS SÃO CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL ESPECIAL, COM ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. VERSATILIDADE NO ÂNGULO DA APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

96	AGULHA DE IRRIGAÇÃO ENDODONTICAS ESTÉREIS	40,000	Caixa
----	---	--------	-------

Especificação: DE USO ÚNICO - BAIXO CUSTO, EMBALADAS UNITARIAMENTE. EVITA OS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO. DE DIMENSÃO 25 X 0,4 MM. CARACTERÍSTICAS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA USO ODONTOLÓGICO. AGULHA COM CANHÃO DE CONICIDADE 6% UNIVERSAL CONECTADO EM TODAS AS SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, FACILITANDO OS PROCEDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO. SEM BISEL (SEM PONTA) NÃO APRESENTA RISCO E DANOS AOS TECIDOS E ACIDENTES. APLICAÇÃO. PROJETADAS PARA AUXILIAR A LIMPEZA DAS RAÍZES E CANAIS. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

97	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO	2,000	Kit
----	------------------------------------	-------	-----

Especificação: EMBALAGEM COM LÍQUIDO- FRASCO COM 15 ML. COMPOSIÇÃO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%, E PÓ FRASCO COM 38G. COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, POLIMETACRILATO DE METILA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

98	CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL	50,000	Kit
----	--	--------	-----

Especificação: PÓ E LÍQUIDO. APRESENTA BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS, RADIOPAVIDADE E IMPERMEABILIDADE. POSSUI FINA GRANULAÇÃO, PROPORCIONANDO UMA MISTURA HOMOGÊNEA E UM PERFEITO ESCOAMENTO. APRESENTAÇÃO: 01 FRASCO COM 12G DE PÓ E 01 FRASCO COM 10 ML DE LÍQUIDO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

99	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	2,000	Kit
----	-----------------------------	-------	-----

Especificação: COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BIOCAMPATÍVEL, RADIOPAVO E AUTO-ENDURECÍVEL INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE QUE NÃO INIBEM A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS AUTO OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS E APRESENTAM UMA COLORAÇÃO SEMELHANTE À DA DENTINA. KIT COM PASTA BASE (13G), PASTA CATALISADORA (11G) E BLOCO DE MISTURA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

100	CIMENTO OBTURADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	40,000	Kit
-----	--	--------	-----

Especificação: OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL. APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPAVIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCAMPATIBILIDADE. APRESENTAÇÃO. KIT COM 1 FRASCO DE PÓ COM 8 GR E 1 BISNAGA DE RESINA COM 7,5 GR. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

101	CIMENTO REPARADOR	3,000	Caixa
-----	-------------------	-------	-------


guelh
@
J



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0229
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

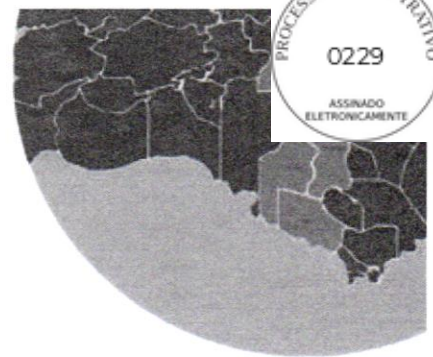


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
	Especificação: CIMENTO REPARADOR PARA COMPLICAÇÕES ENDODÔNTICAS - TRATAMENTO DE PERFURAÇÕES DE CANAL RADICULAR OU FURCA. SELAMENTO DE REABSORÇÕES INTERNAS E INTERNAS COMUNICANTES. RETROBTURAÇÃO EM CIRURGIAS PARENDODÔNTICAS. CAPEAMENTO PULPAR EM TRATAMENTOS CONSERVADORES (PROTEÇÃO PULPAR DIRETA E PULPOTOMIA EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS). APEXIFICAÇÃO E APEXIGÊNESE. SELAMENTO INTRACORONÁRIO PRÉVIO AO CLAREAMENTO DENTAL INTERNO DE DENTES DESPOLDADOS. SELAMENTO APICAL (PLUG) PARA OBTURAÇÃO RADICULAR EM CANAIS COM ABERTURA APICAL AMPLA. LIBERAÇÃO DE ÍONS CÁLCIO: AUXILIA NA RÁPIDA RECUPERAÇÃO ÓSSEA E FORMAÇÃO DO CEMENTO. MATERIAL ODONTOLÓGICO INDUTOR DE NEOFORMAÇÃO DE CEMENTO PERIRRADICULAR: VEDAMENTO BIOLÓGICO, HIDROFÍLICO: PERMITE UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE ÚMIDO SEM PERDA DE PROPRIEDADES. ALTA ALCALINIDADE: PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. BAIXA SOLUBILIDADE: NÃO PERMITE INFILTRAÇÃO MARGINAL. ÓXIDO DE CÁLCIO: PROMOVE A BIOCOMPATIBILIDADE TECIDUAL. AGREGADO DE ÓXIDOS: BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. ALTA RADIOPAVIDADE: EXCELENTE VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA. TEMPO DE PRESA DE 15 MINUTOS: TEMPO DE PRESA FINAL REDUZIDO COMPARADO AOS SIMILARES. RENDIMENTO 07 PORÇÕES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA		
102	CONE ENDODÔNTICO	24,000	EMBALAGEM 120 UNIDADE
	Especificação: TIPO: ABSORVENTE MATERIAL: PAPEL CALIBRE: 1ª SÉRIE COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SORTIDA ESTERILIDADE: ESTÉRIL		
103	CONE ENDODÔNTICO	12,000	EMBALAGEM 120 UNIDADE
	Especificação: TIPO: ABSORVENTE MATERIAL: PAPEL CALIBRE: 2ª SÉRIE COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SORTIDA ESTERILIDADE: ESTÉRIL		
104	CONE ENDODÔNTICO	12,000	EMBALAGEM 120 UNIDADE
	Especificação: TIPO: ACESSÓRIO MATERIAL: GUTA-PERCHA CALIBRE: PM(FM) COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS		
105	CONE ENDODÔNTICO	24,000	EMBALAGEM 120 UNIDADE
	Especificação: TIPO: ACESSÓRIO MATERIAL: GUTA-PERCHA CALIBRE: M COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS		
106	CONE ENDODÔNTICO	24,000	EMBALAGEM 120 UNIDADE
	Especificação: TIPO: ACESSÓRIO MATERIAL: GUTA-PERCHA CALIBRE: MF COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS		
107	ESPAÇADOR DIGITAL	2,000	Caixa
	Especificação: CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESAÇÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "D". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.		
108	ESPAÇADOR DIGITAL	2,000	Caixa
	Especificação: CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESAÇÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "C". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.		
109	EUCALIPTOL	2,000	Frasco
	Especificação: USO ODONTOLÓGICO - LÍQUIDO INCOLOR; COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL U.S.P.; UTILIZADO CURATIVO TEMPORÁRIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE CONES; FRASCO COM 20ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.		

Smult
②
✍



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

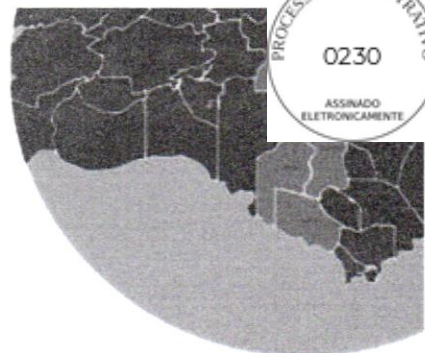


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
110	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO	2,000	FRASCO 10 MILILITRO
Especificação: COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL CONCENTRAÇÃO: 96%			
111	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO	8,000	Unidade
Especificação: COMPOSIÇÃO BÁSICA: METACRILATO ASPECTO FÍSICO: RESINA TIXOTRÓPICA TIPO USO: BARREIRA GENGIVAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOTOPOLIMERIZÁVEL			
112	HIDROXIDO DE CALCIO - PRO ANALISE	6,000	Unidade
Especificação: O HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CAPEADOR PULPAR, É UM DOS MATERIAIS MAIS ACEITOS ATUALMENTE PARA INDUZIR A FORMAÇÃO DA DENTINA REPARADORA, APRESENTANDO PROPRIEDADES IMPRESCINDÍVEIS PARA MATERIAIS QUE ATUAM EM PROCEDIMENTOS SOBRE A DENTINA. EMBALAGEM: FRASCO COM 10G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR A DATA DE ENTREGA.			
113	HIPOCLORITO DE SÓDIO	24,000	Litro
Especificação: ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRAÇÃO: ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO			
114	CLOREXIDINA AQUOSA 2%,	150,000	Litro
Especificação: SOLUÇÃO IRRIGADORA PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO, PROMOVE REDUÇÃO MICROBIANA			
115	MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA	120,000	EMBALAGEM 26 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: LÁTEX NATURAL TIPO: LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO DIMENSÃO: CERCA DE 14 X 14 CM TIPO USO*: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL			
116	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM	24,000	Caixa
Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.			
117	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM-	8,000	Caixa
Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.			
118	LIMA KERR Nº 06, 25MM	8,000	Caixa
Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.			
119	LIMA KERR Nº 08, 21MM-	5,000	Caixa

Handwritten signature and initials in blue ink.



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

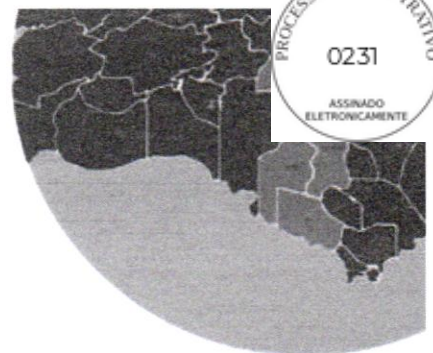

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
------	-----------	------	------

Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.

120	LIMA KERR Nº 08, 25MM	12,000	Caixa
-----	-----------------------	--------	-------

Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.

121	LIMA KERR Nº 10, 21MM	12,000	Caixa
-----	-----------------------	--------	-------

Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.

122	LIMA KERR Nº 10, 25MM	24,000	Caixa
-----	-----------------------	--------	-------

Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.

123	LIMA KERR SÉRIE Nº 15, 21MM-	6,000	Caixa
-----	------------------------------	-------	-------

Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.

124	LIMA KERR Nº 15, 25 MM	24,000	Caixa
-----	------------------------	--------	-------


Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.

125	LIMA KERR Nº 20, 21MM	6,000	Caixa
-----	-----------------------	-------	-------



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

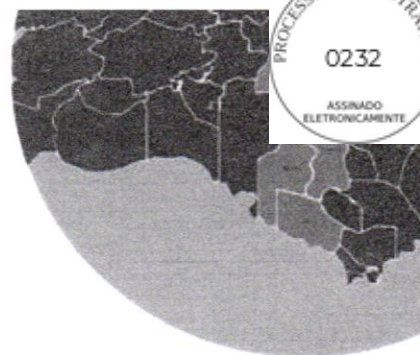

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
------	-----------	------	------

Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304(COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM.INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.

126	LIMA KERR Nº20, 25MM	24,000	Caixa
-----	----------------------	--------	-------

Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304(COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM.INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA DO CANAL DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA. DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO- RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA BACOMPANHANDO A CURVATURA

127	LIMA KERR ESPECIAL Nº25, 21MM	6,000	Caixa
-----	-------------------------------	-------	-------

Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304(COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM.INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.

128	LIMA KERR Nº25, 25MM	12,000	Caixa
-----	----------------------	--------	-------

Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304(COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM.INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.

129	LIMA RECIPROCANTE	24,000	Caixa
-----	-------------------	--------	-------

Especificação: LIMA PARA USO EM MOVIMENTO RECIPROCANTE (PROGRAMA WAVE ONE GOLD OU RECIPROC).LIMA 20/06: IDEAL PARA O 4º CANAL. LIMA 25/06: IDEAL PARA A MAIORIA DOS CASOS. LIMA 40/06: IDEAL PARA O CANAL PALATINO DE MOLARES SUPERIORES. EXCELENTEPODER DE CORTE E RESISTÊNCIA FLEXURAL. POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO DE SUPERFÍCIE BLUE COM CONTROLE DE MEMÓRIA (CM). SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. PONTA INATIVA. TAPER 06. 25MM. INDICADA PARA USO NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES (20.06/25.06/40.05)

130	LIMA RECIPROCANTE COM TRATAMENTO TÉRMICO	12,000	Caixa
-----	--	--------	-------


Especificação: LIMA RECIPROCANTE FABRICADO COM LIGA DE NITI COM TRATAMENTO TÉRMICO BLUE QUE GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA; SUAVE PROGRESSÃO DA LIMA NO CANAL; CONICIDADE DECRESCENTE NO MESMO INSTRUMENTO; PONTA INATIVA; PREPARA O CANAL RADICULAR PARA UM DIÂMETRO DE 0,25 MM COM UMA CONICIDADE DE 0,08 SOBRE OS PRIMEIROS MILÍMETROS APICAIS.QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A RECIPROC BLUE 25. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA

131	LIMA RECIPROCANTE COM TRATAMENTO TÉRMICO	12,000	Caixa
-----	--	--------	-------



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

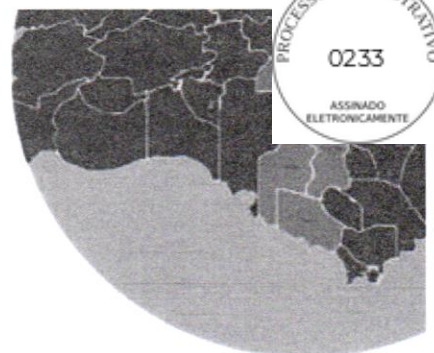


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: LIMA RECIPROCANTE FABRICADO COM LIGA DE NITI COM TRATAMENTO TÉRMICO BLUE QUE GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA; SUAVE PROGRESSÃO DA LIMA NO CANAL; CONICIDADE DECRESCENTE NO MESMO INSTRUMENTO; PONTA INATIVA; PREPARA O CANAL RADICULAR PARA UM DIÂMETRO DE 0,40 MM COM UMA CONICIDADE DE 0,06 SOBRE OS PRIMEIROS MILÍMETROS APICAIS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A RECIPROC BLUE 40. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.			
132	LIMA ROTATÓRIA	12,000	Caixa
Especificação: LIMA ROTATÓRIA UTILIZADA PARA O DESGASTE DO TERÇO CERVICAL DO CANAL RADICULAR, DESGASTANDO NO SENTIDO ANTI-CURVATURA. POSSUI PONTO 17 E TAPER 08, COM 19MM DE COMPRIMENTO. VELOCIDADE RECOMENDADA 350RPM E 2 N. TORQUE. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ORIFICE SHAPER MKLIFE. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.			
133	LIMA USO ODONTOLÓGICO	2,000	CAIXA 6 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: HEDSTROEM COMPRIMENTO: 21 MM APLICAÇÃO: DIGITAL TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40 COMPONENTES: C/ CURSOR APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO			
134	LIMA USO ODONTOLÓGICO	2,000	CAIXA 6 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: HEDSTROEM COMPRIMENTO: 25 MM APLICAÇÃO: DIGITAL TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40 COMPONENTES: C/ CURSOR APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO			
135	LIMA USO ODONTOLÓGICO	2,000	CAIXA 6 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: HEDSTROEM COMPRIMENTO: 21 MM APLICAÇÃO: DIGITAL TAMANHO: 2ª SÉRIE/45 A 80 COMPONENTES: C/ CURSOR APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO			
136	LIMA USO ODONTOLÓGICO	2,000	CAIXA 6 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: HEDSTROEM COMPRIMENTO: 25 MM APLICAÇÃO: DIGITAL TAMANHO: 2ª SÉRIE/45 A 80 COMPONENTES: C/ CURSOR APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO			
137	EDTA USO ODONTOLÓGICO	6,000	Frasco
Especificação: COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ETILENO TETRACÉTICO / HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO APLICAÇÃO: AUXILIAR DE PREPARO DE CANAIS RADICULARES			
138	SOLUÇÃO OTÓPICA A BASE DE HIDROCORTISONA	6,000	Frasco
Especificação: SULFATO DE NEOMICINA E SULFATO DE POLIMIXINA B. SUSPENSÃO OTOLÓGICA HIDROCORTISONA 10 MG + SULFATO NEOMICINA 5MG, SULFATO DE POLIMIXINA 10.000 UI/ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.			
139	CURSOR ODONTOLÓGICO	2,000	CAIXA 100 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: SILICONE TIPO USO: REUTILIZÁVEL ODOR: INODORO DIÂMETRO: 3 MM APLICAÇÃO: LIMA LIMPEZA CANAL RADICULAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, ESTERILIZÁVEL E COM ORIFÍCIO CENTRAL			
140	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO	6,000	FRASCO 200 MILILITRO
Especificação: APLICAÇÃO: TESTE DE VITALIDADE PULPAR APRESENTAÇÃO: AEROSOL TEMPERATURA: CERCA DE - 50°C			
141	TRICRESOL FORMALINA-	6,000	Unidade
Especificação: COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL E COMPOSTOS FENOLICOS. FRASCO COM 20 ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.			
142	CONE DE PAPEL ABSORVENTE F1, F2, F3	48,000	Caixa

Handwritten signature and initials




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

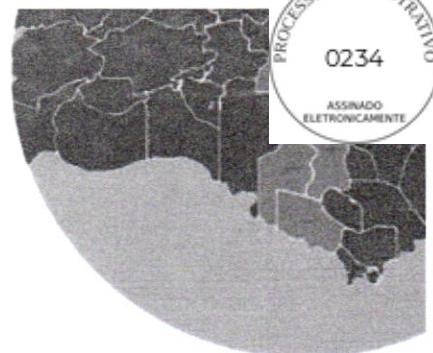

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES PREPARADOS POR SISTEMAS DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS/RECIPROCANTE, CORRESPONDENTE AOS SISTEMAS PROTAPER, TAMANHO F1, F2 E F3			
143	CONE GUTA PERCHA F1, F2, F3	96,000	Caixa
Especificação: INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAL DURANTE O TRATAMENTO COM OS SISTEMAS RECIPROCANTE COM DIÂMETRO DE PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTE AOS SISTEMAS PROTAPER. CAIXA COM 20 CONES DE GUTAPERCHA F1, 20 CONES DE GUTAPERCHA F2 E 20 CONES DE GUTAPERCHA F3.			
144	ARCO ODONTOLÓGICO	5,000	Unidade
Especificação: MATERIAL: PLÁSTICO TIPO: YOUNG TIPO USO: REUTILIZÁVEL FORMA: U APLICAÇÃO: ESTICAR LENÇOL BORRACHA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISOLAMENTO DENTAL			
145	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013	6,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
146	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 HL	36,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
147	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014	6,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
148	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA	36,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
149	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015	6,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
150	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016	6,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
151	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA	14,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
152	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019	2,000	Unidade



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

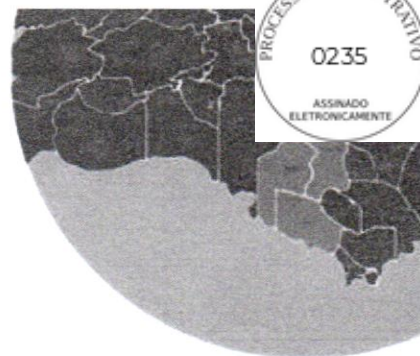


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
153	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 FF	4,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
154	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118 F	12,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
155	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118 FF	12,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
156	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195 F	4,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
157	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195 FF	4,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
158	BROCA ALTA ROTAÇÃO 4138	20,000	Unidade
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
159	BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO	10,000	Unidade
Especificação: TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA, NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. SUA PONTA É INATIVA, APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO. O MODELO DE ALTA ROTAÇÃO POSSUI 21MM DE COMPRIMENTO E TENDO PARTE ATIVA DE 9MM. BLISTER CONTENDO 01 UNIDADE.; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
160	BROCA GATES Nº 2 DE 28 MM	4,000	Caixa
Especificação: (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
161	BROCA GATES Nº 3 DE 28MM	4,000	Caixa

travell
Ⓢ
Ⓢ




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

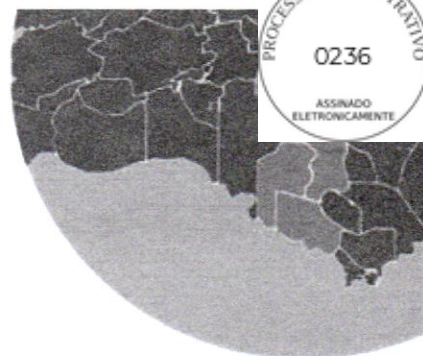


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: (DIÂMETRO 0,90), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
162	BROCA GATES Nº 4 DE 28 MM	4,000	Caixa
Especificação: (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
163	BROCA GATES Nº 5 DE 28 MM	4,000	Caixa
Especificação: (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. . PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
164	BROCA GATES Nº 6 DE 28MM	4,000	Caixa
Especificação: EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
165	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO NUMERO 700C HASTE LONGA	5,000	Unidade
Especificação: PARA ALTA ROTAÇÃO; AÇO CARBIDE; CÔNICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
166	BROCA ALTA ROTAÇÃO	5,000	Unidade
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: TRONCO CÔNICA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA TIPO HASTE: HASTE LONGA TIPO CORTE: CIRÚRGICA NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 701			
167	BROCA ALTA ROTAÇÃO	25,000	Unidade
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: TRONCO CÔNICA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA TIPO HASTE: HASTE LONGA TIPO CORTE: CIRÚRGICA NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 702			
168	BROCA ALTA ROTAÇÃO	5,000	Unidade
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: TRONCO CÔNICA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA TIPO HASTE: HASTE LONGA TIPO CORTE: CIRÚRGICA NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 703			
169	BROCA ODONTOLÓGICA CARBIDE TUNGSTÊNIO MINICUT	5,000	Unidade
Especificação: DE FORMA TRONCO CÔNICA. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO, AMERICAN BURNS NUMERO 1520 PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
170	BROCA ODONTOLÓGICA CARBIDE TUNGSTÊNIO MINICUT	2,000	Unidade
Especificação: DE FORMA AGULHA CRUZADO FINO. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO, AMERICAN BURNS NUMERO 1511 PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			

Handwritten signature and initials



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

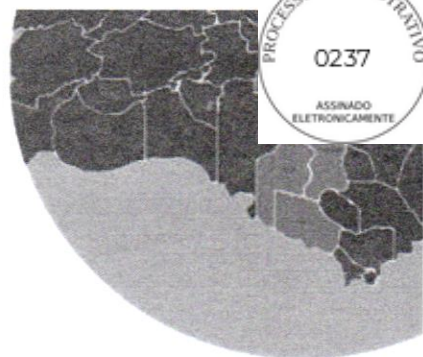


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
171	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE TUNGSTENIO MINICUT	2,000	Unidade
Especificação: PERA CRUZADO FINO. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO, AMERICAN BURNS NUMERO 1517 PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PERA CRUZADO FINO 1517			
172	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE TUNGSTENIO MIAXCUT	2,000	Unidade
Especificação: TRONCO CONICA. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO, AMERICAN BURNS NUMERO 1510 PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
173	BROCA ALTA ROTAÇÃO	4,000	Unidade
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: CILÍNDRICA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TRANSMETAL TIPO HASTE: 19 MM TIPO CORTE: CORTE GROSSO PONTA ATIVA: 12 MM DIÂMETRO			
174	BROCA ALTA ROTAÇÃO	4,000	Unidade
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: CILÍNDRICA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TRANSMETAL TIPO HASTE: 25 MM TIPO CORTE: CORTE GROSSO PONTA ATIVA: 12 MM DIÂMETRO			
175	BROCA ALTA ROTAÇÃO	2,000	Unidade
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: CÔNICA LONGA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO TIPO HASTE: HASTE REGULAR TIPO CORTE: ZEKRYA REFERÊNCIA: REF. 199			
176	BROCA ALTA ROTAÇÃO	2,000	Unidade
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: CÔNICA LONGA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO TIPO HASTE: HASTE LONGA TIPO CORTE: ZEKRYA REFERÊNCIA: REF. 199			
177	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	3,000	Unidade
Especificação: COM CORPO PLÁSTICO, CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
178	ESCOVA DE ROBSON	200,000	Unidade
Especificação: PARA CONTRA ÂNGULO - TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
179	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO	150,000	Unidade
Especificação: MATERIAL: SILICONE FORMATO: TAÇA COR: BRANCA APLICAÇÃO: PROFILAXIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL COMPATIBILIDADE: CONTRA ÂNGULO			
180	ETIQUETAS PARA ETIQUETADORA	120,000	Rolo
Especificação: COM TRÊS LINHAS -SISTEMA DE RASTREABILIDADE COM IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS E PACOTES ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM DUPLA CAMADA ADESIVA. DIMENSÃO: 27MM X 28MM EM ROLOS DE 500 ETIQUETAS. MÁQUINA ETIQUETADORA TRÊS LINHAS (EM CONTRATO DE COMODATO) - SISTEMA DE RASTREABILIDADE SENDO NÚMEROS E SÍMBOLOS COM CAPACIDADE PARA ROLOS COM 500 ETIQUETAS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
181	REFIL DE TINTA PARA ETIQUETADORA;	24,000	Unidade
Especificação: APRESENTAÇÃO ROLETE; COMPATÍVEL COM ETIQUETADORA BROWNE DE 3 LINHAS DE IMPRESSÃO			
182	INDICADOR BIOLÓGICO	600,000	Unidade
Especificação: TIPO: TERCEIRA GERAÇÃO APRESENTAÇÃO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA ESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM 3 HORAS APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR			
183	INDICADOR QUÍMICO	2.500,000	Unidade
Especificação: CLASSE: CLASSE V TIPO USO: INTERNO TIPO: INTEGRADOR APRESENTAÇÃO: PÍLULA			
184	TESTE DE BOWIE & DICK (PACOTE PRONTO)	250,000	Pacote

Insulh
@
P



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

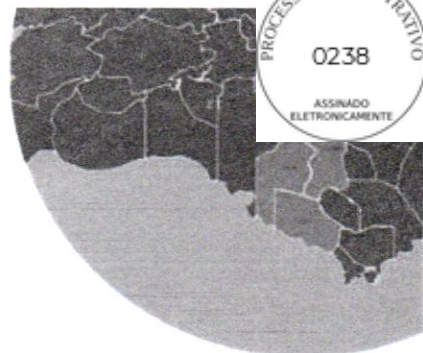


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: PARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ASSISTIDAS POR BOMBA DE VÁCUO. CONSTITUÍDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES INSERIDOS EM PACOTES. ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO PARA PRONTO USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. APRESENTAÇÃO PCT. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
185	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO	16,000	Pacote
Especificação: DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTO-CONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
186	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 100 MTS	96,000	BOBINA TUBULAR
Especificação: COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS,CORANTES,ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO,QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL,GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA,CONF.NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE,DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF.RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
187	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 MTS	48,000	BOBINA TUBULAR
Especificação: COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE UROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS,CORANTES,ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA,CONF.NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95% (BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE,DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF.RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
188	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100 MTS	36,000	BOBINA TUBULAR
Especificação: COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO,QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL,GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA,CONF.NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF.RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
189	PAPEL GRAU CIRURGICO 300 MM X 100 MTS	12,000	BOBINA TUBULAR
Especificação: COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FUROS ,RASGOS, RUGAS, MANCHAS,SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO,QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF.NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 5%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE,DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF.RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			

Handwritten signature and initials



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

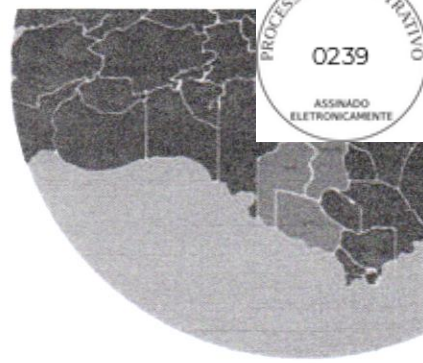

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
190	DESINFETANTE	30,000	Litro

Especificação: COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO PRINCÍPIO ATIVO: DIDECILMETILAMÔNIO + BIGUANIDA + TENSOATIVOS TEOR ATIVO: TEOR ATIVO CERCA DE 0,1% FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA

191	DETERGENTE ENZIMÁTICO NEUTRO	6,000	BOBONA 5 LITROS
-----	------------------------------	-------	-----------------

Especificação: À BASE DE ENZIMA CELULASE, PROTEASE, LÍPASE E AMILASE, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. INDICADO PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM GERAL, INSTRUMENTAIS MICROTUBULARES, PINÇAS DE BIÓPSIA E TODOS OS FIBROSCÓPIOS PARA QUALQUER ESPECIALIDADE MÉDICA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

192	MULTIENZIMATICO	12,000	BOBONA 5 LITROS
-----	-----------------	--------	-----------------

Especificação: DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1000 À 5.000 ML, DILUIÇÃO DE 2,0 ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODORE AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR LAUDOS QUE COMPROVEM: ESTABILIDADE DAS ENZIMAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO, ESTABILIDADE DO SISTEMA CONSERVANTE, BIODEGRADABILIDADE, CORROSIVIDADE EM METAIS. OS LAUDOS DEVEM SER DE LABORATÓRIOS EXTERNOS. ACONDICIONAMENTO EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE. AS EMPRESAS DEVERÃO COTAR NA PROPOSTA O PREÇO DO LITRO DILUÍDO, PORÉM A ENTREGA SE FARÁ COM A SOLUÇÃO CONCENTRADA. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA E QUE ATENDA A NOVA RDC. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

193	DESINCROSTANTE LIQUIDO	2,000	Litro
-----	------------------------	-------	-------

Especificação: BASE ÁCIDO FOSFÓRICO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM ARTIGOS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. INDICAÇÃO: É INDICADO PARA DESINCROSTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DAR BRILHO EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHAS PROFISSIONAIS. PRODUTO CONCENTRADO. APRESENTAÇÃO:FRASCO DE 1 LITRO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

194	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL	12,000	Unidade
-----	---	--------	---------

Especificação: INDICADA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL: TESOURAS, PINÇAS HEMOSTÁTICAS E OUTROS. POSSUI 17,78 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES, SENDO QUE EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI TRÊS FILAS DE CERDAS PARA DESCONTAMINAÇÃO GERAL E, NA OUTRA EXTREMIDADE, CONTÉM UMA ÚNICA FILEIRA DE CERDAS PARA DESCONTAMINAÇÃO DELICADA E FINA. POSSUI CABO ANTIDERRAPANTE QUE FACILITA O USO.FORMATO DIVERSOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

195	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE	24,000	Unidade
-----	-----------------------------------	--------	---------

Especificação: MATERIAL: PAPELÃO CAPACIDADE TOTAL: 7 L ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE TIPO USO: DESCARTÁVEL

196	SUPORTE	2,000	Unidade
-----	---------	-------	---------

Especificação: MATERIAL: METAL APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLETOR DE 7 LITROS

197	ESPELHO BUCAL	3,000	Caixa
-----	---------------	-------	-------

Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO TIPO: PLANO TAMANHO: Nº 3 USO: ENCAIXE UNIVERSAL TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 12 UNIDADES

198	ESPELHO BUCAL	6,000	Caixa
-----	---------------	-------	-------


Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO TIPO: 1º PLANO TAMANHO: Nº 5 USO: ENCAIXE UNIVERSAL TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 12 UNIDADES

199	CABO ESPELHO BUCAL	24,000	Unidade
-----	--------------------	--------	---------

Handwritten signatures and marks:
- A blue checkmark-like mark.
- A blue circle with a dot inside.
- A blue stylized signature.



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

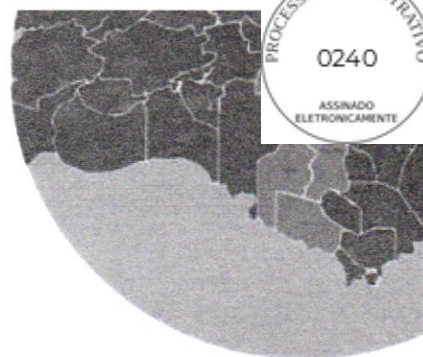


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FORMATO: OITAVADO TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL			
200	BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	4,000	Unidade
Especificação: DE TITÂNIO OU TUNGSTÊNIO, INDICADAS PARA O USO EM ESTRUTURAS DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
201	BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	4,000	Unidade
Especificação: DE TITÂNIO OU TUNGSTÊNIO, INDICADAS PARA O USO EM ESTRUTURAS DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
202	BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	4,000	Unidade
Especificação: DE TITÂNIO OU TUNGSTÊNIO, INDICADAS PARA O USO EM ESTRUTURAS DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
203	BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08	4,000	Unidade
Especificação: DE TITÂNIO OU TUNGSTÊNIO, INDICADAS PARA O USO EM ESTRUTURAS DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
204	CIMENTO ENDODÔNTICO	3,000	Caixa
Especificação: MATERIAL PARA PREENCHIMENTO DE CANAIS RADICULARES, À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E IODOFÓRMIO EM VEÍCULO VISCOSO, RADIOPACO, PRONTA PARA O USO PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
205	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO	3,000	Unidade
Especificação: COMPONENTE BÁSICO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO ASPECTO FÍSICO: PASTA APLICAÇÃO: ODONTOLÓGICA, RESTAURAÇÃO ENDODÔNTICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 TUBETE, CADA UM CONTENDO 2,7 G, MAIS UM TUBETE			
206	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL	24,000	Caixa
Especificação: REFORÇADO COM RESINA. APRESENTAÇÃO EM CÁPSULA, CAIXA COM 50 UNIDADES PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
207	RESINA COMPOSTA	12,000	SERINGA 4 GRAMA
Especificação: TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL " ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE			
208	RESINA COMPOSTA	12,000	SERINGA 2.5 GRAMA
Especificação: TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA ASPECTO FÍSICO: FLUIDA/FLOW A2			
209	MATRIZ ODONTOLÓGICA	1,000	CAIXA 64 UNIDADE
Especificação: MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA APLICAÇÃO: DENTES DECÍDUOS ANTERIORES E POSTERIORES FORMATO: COROAS COMPLETAS APRESENTAÇÃO: CONJUNTO SORTIDO TIPO USO: DESCARTÁVEL			
210	Alavanca Potts - Quinelato	12,000	Unidade
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável. * Direita			
211	Alavanca Potts - Quinelato	12,000	Unidade
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável. * Esquerda			
212	Alavanca Apexo - Quinelato	2,000	Unidade

rmu
@
+



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

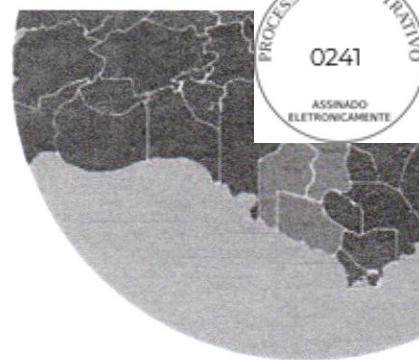

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável. * Possui parte ativa serrilhada * 301			
213	Alavanca Apexo - Quinelato	2,000	Unidade
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável. * Possui parte ativa serrilhada, * 303			
214	Kit Alavanca Seldin Adulto com 3 unidades	12,000	Kit
Especificação: Jogo com 3 unidades. (1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta. Tamanho: 15 cm). Produto autoclavável. Possuem lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.			
215	Porta Agulha Com Videa 14 CM	12,000	Unidade
Especificação: Tipo De Alicates: Reta Comprimento:14 cm			
216	Tesoura Cirurgica Iris Reta 11,5cm - Quinelato	12,000	Unidade
Especificação: * Comprimento: 11,5 cm; * Reta; * Modelo Quinelato: Iris; * Código Quinelato: QT. 822.11; * Aço inoxidável; * Autoclavável.			
217	Tesoura Cirurgica Iris Curva 11,5cm - Quinelato	12,000	Unidade
Especificação: * Comprimento: 11,5 cm; * Curva; * Modelo Quinelato: Iris; * Código Quinelato: QT. 823.11; * Aço inoxidável; * Autoclavável.			
218	Pinça Mosquito Curva 12,5cm	2,000	Unidade
Especificação: * Totalmente autoclavável; * Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; * Validade: Indeterminada;			
219	Lima Seldin para Osso Nº 1 - Ref. QD.610.01 - Quinelato	10,000	Unidade
Especificação: * Aço Inox. * Autoclavável.			
220	Cinzel Cirurgico Bi-Bizel	1,000	Unidade
Especificação: Material: aço inox, um material durável, resistente à corrosão e fácil de limpar; Acabamento: de ótima qualidade, que evita o acúmulo de sujeira e bactérias, e proporciona um aspecto brilhante e agradável ao instrumento; Pontas: afiadas e anguladas, que permitem cortar o tecido ósseo com precisão e facilidade, sem causar danos aos tecidos adjacentes; O produto possui duas pontas, uma em cada extremidade do instrumento, que podem ser usadas alternadamente ou simultaneamente, dependendo da necessidade do procedimento.			
221	Martelo Mead	1,000	Unidade
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável.			
222	Sonda Exploradora 47	30,000	Unidade
Especificação: A Sonda Exploradora 47 é uma ferramenta fundamental para profissionais da odontologia, especialmente em procedimentos de dentística e endodontia. Material: Aço Inoxidável AISI 420. Cabo: Oitavado. Autoclavável. Registro ANVISA: 10401319007.			
223	Tentacânula Odontologia	2,000	Unidade
Especificação: Com 15 cm de comprimento, este equipamento cirúrgico foi projetado para proporcionar suporte preciso e seguro durante os procedimentos, garantindo maior eficiência e segurança no consultório odontológico. Proteção dos tecidos adjacentes; Precisão cirúrgica; Apoio ao cirurgião; Durabilidade e resistência.			
224	Régua Endodôntica Milimetrada 35mm Plástica Autoclavável	5,000	Unidade
Especificação: - Esterilizável em estufa e autoclave. Leve: produzida em polímero de alta performance. - Garantia de qualidade. - Produzida em polímero de alta performance. Leve. - Resistente à ataque químico.			
225	Conjunto de Aspiração Endodôntico 1 Cânula + 3 Agulhas	15,000	Unidade
Especificação: A cânula com engate sem roscas facilita a higienização; Autoclavável; MEDIDAS DO PRODUTO: Agulha 4010: 49,1 mm x Ø 1,25mm. Agulha 4015: 49,2mm x Ø 1,50mm. Agulha 5020: 49,3mm x Ø 2,00mm. Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo).			

Brasil
10
J

Avenida Leão Sampaio, s/n CEP: 63.180-000, Borbalha - CE

Telefone: (88) 3532-3386

cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br

@cpsmjn


SESA



SECRETARIA
DA SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

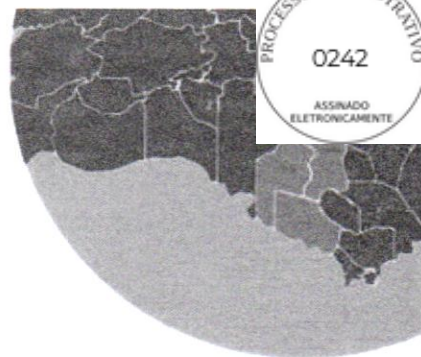

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
226	Grampo Para Isolamento Absoluto	20,000	Unidade

Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° 00: Indicado para pequenos pré-molares. Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização. Também são usados em odontopediatria.

227	Grampo Para Isolamento Absoluto	15,000	Unidade
-----	---------------------------------	--------	---------

Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° 201: Indicado para molares superiores, com garras levemente arredondadas. As projeções das garras estão de acordo com a linha de curvatura da gengiva, proporcionando melhor estabilidade.

228	Grampo Para Isolamento Absoluto	20,000	Unidade
-----	---------------------------------	--------	---------

Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° 26: Indicado para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento e dá mais estabilidade.

229	Grampo Para Isolamento Absoluto	20,000	Unidade
-----	---------------------------------	--------	---------

Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° W8A: Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em molares deciduos.

230	Grampo Para Isolamento Absoluto	20,000	Unidade
-----	---------------------------------	--------	---------

Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° 209: Indicado para pequenos pré-molares inferiores. De garras planas e pequenas.

231	Grampo Para Isolamento Absoluto	15,000	Unidade
-----	---------------------------------	--------	---------

Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° 212: Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores.

232	Pinça Clínica Para Algodão N° 317	20,000	Unidade
-----	-----------------------------------	--------	---------

Especificação: Pertence à família de instrumental cirúrgico não articulado não cortante. Fabricado nos padrões de qualidade internacional. Pinça clínica também usualmente conhecida como Pinça para Algodão. Possui pino guia. Feita em aço inoxidável (Aço Inox AISI 420). É autoclavável. Garantia pelo fabricante: 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Registro ANVISA: 10401319007.

233	Moldeira Total Perfurada Adulto Alumínio	3,000	Kit
-----	--	-------	-----

Especificação: Material: Alumínio. Modelo: Adulto; Paciente Dentado. Autoclavável: Sim. Apresentação: Embalagem com 11 moldeiras (5 superiores: S1, S2, S3 S4 e S5; 4 inferiores: I1, I2, I3 I4 e I5; 1 giratória: 87). Categoria: Moldagem e Modelo, Moldeira para Moldagem. Registro ANVISA: 10409360002.

234	Moldeira Total Perfurada de Plástico	10,000	Kit
-----	--------------------------------------	--------	-----

Especificação: Tamanho 3 - Inferior/Superior Embalagem com 2 unidades (1 inferior e 1 superior). Modelo: Infantil Produto autoclavável, esterilização em autoclave até 134°C. Moldeira total, apresenta bordas arredondadas e lisas, canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais que aumentam a retenção do material. Moldeira plástica disponível na cor branca. Composição: nylon com fibra de vidro e pigmento branco. Armazenamento: nas embalagens para esterilização em local limpo, ao abrigo da luz solar direta e da umidade. Temperatura inferior a 30°C. Umidade inferior a 75 UR. Validade: indeterminada. Após aberto o produto possui validade de 50 ciclos de esterilização. Registro ANVISA: 80322400024.


235	Moldeira Total Perfurada Adulto Alumínio Dentado	10,000	Unidade
-----	--	--------	---------

Especificação: Embalagem com 1 unidade, para pacientes dentados. Tamanho: N° 2 Inferior Modelo: Perfurado. Uso: Para pacientes dentados. Cabo: Muito mais espesso para empunhadura segura e perfeita, com o mínimo de flexão na moldagem. Registro ANVISA: 10409360002.

travh
⑩
✱



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

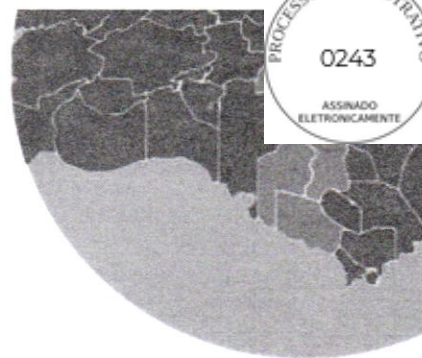

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
236	Moldeira Total Perfurada Adulto Alumínio Dentado	10,000	Unidade
Especificação: Embalagem com 1 unidade, para pacientes dentados. Tamanho: Nº 2 Superior Modelo: Perfurado. Uso: Para pacientes dentados. Cabo: Muito mais espesso para empunhadura segura e perfeita, com o mínimo de flexão na moldagem. Registro ANVISA: 10409360002.			
237	Óculos De Proteção Epi Incolor Sobrepor Óculos De Grau	25,000	Unidade
Especificação: Materiais: Policarbonato Cor da lente: Incolor Tipo de tratamento da lente: Sobrepor			
238	Pontas Eletrodos De Baixa Para Bisturi Elétrico	2,000	Kit
Especificação: Kit de Eletrodos de Baixa para Bisturi Eletrônico Emai. Compatíveis com aparelho de Bisturi Eletrônico Odontológico Microprocessado BO 1300 MP Kit com 6 Eletrodos Autoclaváveis p/ Bisturi Acompanha: 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) Ref: EFR-67 1 Eletrodo tipo bola (2,1mm) Ref: EB-2.1 1 Eletrodo tipo bola (4,2mm) EB-4.2 1 Eletrodo tipo alça pequena (4,5mm) Ref: EAL-4.5 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) Ref:EA-85 1 Eletrodo tipo agulha depilação (66mm) Ref: EA-66.			
239	Motor Endodôntico	3,000	Unidade
Especificação: Motor Rotatório e Reciprocante c/programação de ângulo reciprocante de 10 em 10 graus; Leve, compacto, sem fio; Localizador integrado; Velocidade programável até 1000 RPM; Torque programável até 4N; Compatível com todos os sistemas de limas; Motor Rotatório e Reciprocante (esquerda e Direita); Torque (0,5 a 4N) e velocidade (de 120 a 1000 RPM); Auto-reverse, Auto-stop; Mini contra ângulo push-button; Programação Personalizada: Conta com programas personalizados, pré-programados para diferentes técnicas de endodontia. Garantia: 1ano pelo fabricante Qualidade igual superior a marca Endopen - Schuster.			
240	Alicate Ortodôntico Weingart com Wídia	2,000	Unidade
Especificação: Possui pontas longas e finas e que possuem um serrilhado em sua parte interna. Pode ser empregado também para a inserção da presilha de uma barra transpalatina no tubo lingual e para a realização da dobra distal no extremo de um arco. Apresenta maior resistência e durabilidade, assegurando a apreensão de fios com maior segurança. Pontas ativas feitas em wídia (carboneto de tungstênio), material resistente livre de corrosão, que oferece precisão e durabilidade. Confeccionada em aço cirúrgico de alta qualidade. O processo para a reutilização do alicate envolve sete etapas básicas e fundamentais: desinfecção, limpeza prévia, enxágue, secagem, inspeção visual, embalagem e esterilização. Garantia pelo fabricante: 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA: 80328810069.			
241	Abridor de Boca Molt Infantil	2,000	Unidade
Especificação: * Embalagem com 1 unidade; * Tamanho: Infantil; * Fabricado em aço inox; * Autoclavável. * Não Cortante. * Tamanho: 11 cm.			
242	Alicate Ortodôntico 139	5,000	Unidade
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável.			
243	CONDICIONADOR DENTAL	12,000	Pacote
Especificação: TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO CONCENTRAÇÃO: 37% ASPECTO FÍSICO: GEL SERINGA 2,5 MILITRO			
244	ADESIVO DENTAL	12,000	Frasco
Especificação: TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL COMPONENTES: MONOCOMPONENTE FRASCO 4 MILILITRO			

7. Estimativa do valor da contratação

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	ABAIXADOR LÍNGUA	12,000	PACOTE 100 UNIDADE	9,90	118,80
Especificação: MATERIAL: MADEIRA TIPO: DESCARTÁVEL COMPRIMENTO: 14 CM FORMATO: TIPO ESPÁTULA LARGURA: 1,50 CM ESPESSURA: 2 MM					
2	AGULHA ODONTOLÓGICA	60,000	CAIXA 100 UNIDADE	53,41	3.204,60



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO APLICAÇÃO: GENIVAL / ANESTESIA DIMENSÃO: 30 G CURTA TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE					
3	AGULHA ODONTOLÓGICA	6,000	CAIXA 100 UNIDADE	47,15	282,90
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO APLICAÇÃO: GENIVAL / ANESTESIA DIMENSÃO: 27 G LONGA TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE					
4	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5%	5,000	FRASCO 1 LITRO	10,76	53,80
Especificação: EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMBALAGEM CONTENDO 1L. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
5	ÁLCOOL ETÍLICO 70%	6,000	BOBONA 5 LITROS	47,15	282,90
Especificação: EM GEL HIGIENIZANTE ANTISSÉPTICO HIDRATANTE PARA AS MÃOS, SECA INSTANTANEMENTE. EMBALAGEM CONTENDO 5L. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
6	ÁLCOOL ETÍLICO 70%	150,000	FRASCO 1 LITRO	8,80	1.320,00
Especificação: EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM CONTENDO 1L. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
7	ALGODÃO	120,000	PACOTE 100 UNIDADE	8,16	979,20
Especificação: TIPO: HIDRÓFILO APRESENTAÇÃO: EM ROLETE MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS PESO: 25 G					
8	ALGODÃO HIDRÓFILO	6,000	PACOTE 500 GRAMAS	15,99	95,94
Especificação: EM MANTA FINA DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBRE POSTAS, REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PESO: 500G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA					
9	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%	100,000	Caixa	224,00	22.400,00
Especificação: COM VASOCONSTRICTOR DE EPINEFRINA 1:100.000. ACONDICIONADO EM TUBETE DE VDRO. EMBALAGEM COM 50 TUBETES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA					
10	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3%	2,000	Caixa	227,20	454,40
Especificação: SEM VASOCONSTRICTOR - EM TUBETES 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES. USO INJETÁVEL. CARPULE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
11	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA	2,000	Caixa	110,70	221,40
Especificação: COM FENILEFRINA ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA COM TUBETES EM VIDRO 1.100.000 PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA LISTA DE ENTREGA					
12	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA HCL 2%	190,000	Caixa	214,60	40.774,00
Especificação: COM VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA -1:100.000 COM TUBETES EM VIDRO 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES. USO INJETÁVEL. CARPULE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
13	BENZOCAÍNA	10,000	POTE 12 GRAMA	17,60	176,00

Avenida Leão Sampaio, s/n CEP: 63.180-000 - Barbalha - CE

Telefone: (88) 3532-3386

cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br

@cpsm.jn

SESA



SECRETARIA
DA SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: CONCENTRAÇÃO: 20% USO: GEL TÓPICO					
14	ANTISSÉPTICO BUCAL	12,000	Litro	35,20	422,40
Especificação: GLUCONATO DE CLOREXIDINA - COM CONCENTRAÇÃO DE 0,12 PORCENTO + 0,5 PORCENTO FLUORETO DE SÓDIO; UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECÇÃO CARIOGÊNICA, GENGIVITE; SOLUÇÃO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR VARIADO. EMBALAGEM COM 1 LITRO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA					
15	APLICADOR ODONTOLÓGICO	10,000	PACOTE 100 UNIDADE	22,99	229,90
Especificação: TIPO HASTE: DOBRÁVEL TIPO USO: DESCARTÁVEL APLICAÇÃO: ADESIVOS DENTINÁRIOS, MAT. LIQ. OU DE BAIXA VISC.					
16	AVENTAL HOSPITALAR	500,000	Unidade	4,98	2.490,00
Especificação: MATERIAL*: POLIPROPILENO GRAMATURA: CERCA DE 40 G/CM2 COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, Resistente à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias. ESTERILIDADE*: USO ÚNICO					
17	BICARBONATO DE SÓDIO	2,000	Frasco	25,60	51,20
Especificação: INDICADO PARA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO DE PLACAS BACTERIANAS, DEVIDO SEU ALTO GRAU DE PUREZA E POR POSSUIR GRANULAÇÃO EXTRAFINA, PROPORCIONA JATEAMENTO AMPLO, LIVRE E CONTÍNUO. USADO COMO UM ABRASIVO DE ALTA PUREZA. GRANULOMETRIA SUPERFINA. VALIDADE: 2 ANOS. EMBALAGEM COM 250G.					
18	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO	2,000	Unidade	46,66	93,32
Especificação: TIPO: CIMENTAÇÃO ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO					
19	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO	195,000	Unidade	46,99	9.163,05
Especificação: TIPO: RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO					
20	CUNHA ODONTOLÓGICA	1,000	CAIXA 100 UNIDADE	25,80	25,80
Especificação: MATERIAL: MADEIRA TIPO: ANATÔMICA APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL TIPO PONTA: FINA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS					
21	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO	2,000	SERINGA 3 MILILITRO	24,40	48,80
Especificação: COMPOSIÇÃO BÁSICA: OXALATO DE POTÁSSIO CONCENTRAÇÃO: 3% ASPECTO FÍSICO*: GEL					
22	FILME RADIOLÓGICO	2,000	CAIXA 150 UNIDADE	292,00	584,00
Especificação: TIPO: ODONTOLÓGICO DIMENSÕES: 30 X 40 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Modelo Adulto					
23	FIO DENTAL	15,000	Frasco	6,29	94,35
Especificação: ENCERADO, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 METROS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
24	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA	2,000	Rolo	3,64	7,28
Especificação: INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COM RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DISPOSITIVO MECÂNICO COM A FINALIDADE DE CONFERIR AO MATERIAL RESTAURADOR A ANATOMIA NATURAL DO DENTE, ALÉM DE PROTEGER DOS DENTES ADJACENTES DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE PREPARO, CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DO ADESIVO. APRESENTADO EM BOBINA, PODE SER CORTADO NO TAMANHO DESEJADO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL; ESPESSURA DE 0,05MM; FITA MATRIZ DE AÇO DE 0,05MM X 7 MM. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
25	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA	2,000	Rolo	3,45	6,90

Emul
®

φ

Avenida Leão Sampaio, s/n CEP: 63.180-000 - Barbalha - CE

Telefone: (88) 3532-3386


cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br

@cpsmjn

SESA




**SECRETARIA
DA SAÚDE**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

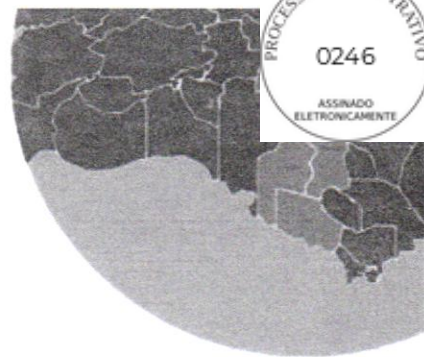

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COM RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL. DISPOSITIVO MECÂNICO COM A FINALIDADE DE CONFERIR AO MATERIAL RESTAURADOR A ANATOMIA NATURAL DO DENTE, ALÉM DE PROTEGER DOS DENTES ADJACENTES DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE PREPARO, CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DO ADESIVO. APRESENTADO EM BOBINA, PODE SER CORTADO NO TAMANHO DESEJADO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL; ESPESSURA DE 0,05MM; FITA MATRIZ DE AÇO DE 0,05MM X 5 MM. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
26	FIXADOR RADIOLÓGICO	2,000	FRASCO 475 MILILITRO	28,12	56,24
Especificação: APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO					
27	FLUORETO DE SÓDIO	6,000	FRASCO 200 MILILITRO	15,50	93,00
Especificação: CONCENTRAÇÃO: 1,23% FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ACIDULADO					
28	GÁS BUTANO REFINADO	60,000	Frasco	35,90	2.154,00
Especificação: GÁS BUTANO DESTILADO E DESODORIZADO COM VÁLVULA PARA ISQUEIROS E MAÇARICOS, CONTENDO 300 ML EM VASILHAME DE 254 G COM BICOS ADAPTADORES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
29	MASSARICO PORTÁTIL	10,000	Unidade	76,50	765,00
Especificação: O Maçarico Portátil Recarregável é prático e versátil, ideal para uso culinário e outras aplicações. Possui tanque para gás butano, ajuste de chama preciso e trava de segurança, proporcionando eficiência e segurança no manuseio. *Utiliza refil para isqueiro com gás butano. Gás butano não incluso. Tamanho: 10,0x11,0x2,5cm					
30	COMPRESSA GAZE	130,000	PACOTE 500 UNIDADE	17,17	2.232,10
Especificação: MATERIAL: 100% ALGODÃO DIMENSÕES: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM GRAMATURA: 9 FIOS/ CM2 ADICIONAL: 5 DOBRAS					
31	GORRO HOSPITALAR	60,000	EMBALAGEM 100 UNIDADE	15,15	909,00
Especificação: MATERIAL*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO MODELO: ELÁSTICO NUCA COR*: SEM COR GRAMATURA*: CERCA DE 30 G/M2 TAMANHO: ÚNICO TIPO USO: DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX					
32	LÂMINA BISTURI	6,000	CAIXA 100 UNIDADE	31,00	186,00
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO: Nº 15 TIPO: DESCARTÁVEL ESTERILIDADE: ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AFIADA E POLIDA, Embalada em papel aluminizado, que preserva a esterilidade até o momento do uso.					
33	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº15C	6,000	CAIXA COM 100 UNIDADES	32,90	197,40
Especificação: EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
34	ÓLEO LUBRIFICANTE.	36,000	FRASCO 200 MILILITRO	35,20	1.267,20
Especificação: APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO ORIGEM: MINERAL USO: CANETA ODONTOLÓGICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDUÇÃO DE ATRITO NA MONTAGEM DA TURBINA E ROLAMEN APLICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS,					

Paul
12
P

Avenida Leão Sampaio, s/n CEP: 63.180-000 - Barbalha - CE

Telefone: (88) 3532-3386

cpsmjuazelrodonorte.ce.gov.br

@cpsm.jn

SESA



SECRETARIA
DA SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
35	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	100,000	CAIXA 100 UNIDADE	33,60	3.360,00
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: EXTRAPEQUENO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA COR: BRANCA TIPO: AMBIDESTRA					
36	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	75,000	CAIXA 100 UNIDADE	34,00	2.550,00
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: GRANDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA COR: BRANCA. EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE.					
37	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	150,000	CAIXA 100 UNIDADE	33,60	5.040,00
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: MÉDIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL TIPO USO: DESCARTÁVEL					
38	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	200,000	CAIXA 100 UNIDADE	33,60	6.720,00
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: PEQUENO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA COR: BRANCA. EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE.					
39	LUVA CIRÚRGICA	500,000	Par	2,22	1.110,00
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: 7 ESTERILIDADE: ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ, BIOABSORVÍVEL E ANTIDERRAPANTE COR: BRANCA LEITOSA TIPO USO: DESCARTÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESPESSURA: 0,19 A 23 MM. EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE					
40	LUVA CIRÚRGICA	500,000	Par	2,22	1.110,00
Especificação: MATERIAL: LÁTEX TAMANHO: 7,50 ESTERILIDADE: ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ, BIOABSORVÍVEL E ANTIDERRAPANTE COR: BRANCA LEITOSA TIPO USO: DESCARTÁVEL FORMATO: ANATÔMICO ESPESSURA: 0,19 A 23 MM. EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE.					
41	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA PROTEÇÃO	150,000	Caixa	11,06	1.659,00
Especificação: ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 50 UN. COM ELÁSTICO; TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS SUPER-RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO; CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO; DESCARTÁVEL; COR BRANCA; EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
42	MÁSCARA N95	30,000	Unidade	2,04	61,20
Especificação: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FORMATO BICO DE PATO, DESENVOLVIDA PARA PROTEGER OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICAS/ PATOLÓGICAS OU EM OUTRAS SITUAÇÕES EM QUE HAJA A EMISSÃO DE PARTÍCULAS OU VAPORES NOCIVOS. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: NÃO ESTÉRIL, POSSUI 6 CAMADAS, SENDO: DUAS CAMADAS DE MELTBONDED (FILTRO PROTETOR); 1 CAMADA EXTERNA DE SPUNBONDED AZUL (ESTÉTICA); 1 CAMADA INTERNA DE SPUNBONDED BRANCO (CONFORTO); 1 CAMADA INTERMEDIÁRIA DE SPUNBONDED (SEPARADOR DOS FILTROS) E 1 CAMADA INTERMEDIÁRIA DE FELTRO (SUSTENTAÇÃO), DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. EXIGÊNCIA: C.A VIGENTE. EMBALAGEM. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO.					
43	PASTA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS	6,000	Unidade	26,90	161,40
Especificação: ESPECIFICAÇÃO: EM SERINGA COM APROX. 4G; CONTENDO UMA PASTA DE UMA PASTA DE GRANULACAO FINA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA					
44	PASTA PROFILÁTICA	12,000	BISNAGA 90 GRAMA	10,72	128,64
Especificação: COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR					

Enviado
@
f



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
45	PEDRA - POMES	2,000	FRASCO 100 GRAMA	18,41	36,82

Especificação: MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA COR: BRANCA ASPECTO FÍSICO: PÓ APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL USO: ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO

46	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES	2,000	Seringa	18,41	36,82
----	---------------------------------------	-------	---------	-------	-------

Especificação: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A1; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR DA DATA DE ENTREGA.

47	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES	4,000	Seringa	16,10	64,40
----	---------------------------------------	-------	---------	-------	-------

Especificação: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A2; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR DA DATA DE ENTREGA.

48	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES	4,000	Seringa	17,85	71,40
----	---------------------------------------	-------	---------	-------	-------

Especificação: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR DA DATA DE ENTREGA.

49	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES	2,000	Seringa	17,85	35,70
----	---------------------------------------	-------	---------	-------	-------

Especificação: RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3, 5; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR DA DATA DE ENTREGA.

50	REVELADOR RADIOLÓGICO	2,000	FRASCO 475 MILILITRO	25,70	51,40
----	-----------------------	-------	----------------------	-------	-------

Especificação: TIPO: SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL

51	SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL	4,000	Kit	29,28	117,12
----	--	-------	-----	-------	--------

Especificação: KIT COM SELANTE 5 ML, ÁCIDO 5ML, BISFENOL A GLICIDILMETACRILATO (35,60%); GRUPOS DIMETACRILATOS; B.H.T.; DIÓXIDO DE SILÍCIO; FLUORETO DE SÓDIO E CATALISADOR. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR DA DATA DE ENTREGA.

52	SERINGA DESCARTÁVEL (5ML) SEM AGULHA	50,000	Caixa	49,50	2.475,00
----	--------------------------------------	--------	-------	-------	----------

total
@
P




CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: É UTILIZADA PARA INJEÇÕES INTRAMUSCULARES, INTRADÉRMICAS E INTRAVENOSAS NO QUE DIZ RESPEITO À: COLETA DE SANGUE, INJEÇÃO DE SOLUÇÕES MEDICAMENTOSAS, ASPIRAR FLUIDOS CORPÓREOS ENTRE OUTROS; CILINDRO TRANSLÚCIDO EM POLIPROPILENO; ÊMBOLO EM POLIPROPILENO DE GRAU MÉDICO; AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL (304 OU ISO 7153-1); RETENTOR HERMÉTICO, QUE GARANTE SUA VEZ DESLIZAMENTO DENTRO DO CILINDRO; CONECTOR TIPO LUER LOCK (CENTRAL); ESCALA VOLUMÉTRICA DEMARCADA EM MILILITROS, DE FÁCIL LEITURA E DOSAGEM EXATA DAS SOLUÇÕES; AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL QUE PERMITE ACESSO INTRAVASCULAR E INTRAMUSCULAR NA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, EXTRAÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS; CÂNULAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA; TAMPA PROTETORA DA CÂNULA EM POLIPROPILENO. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
53	HEMOSTÁTICO TÓPICO	2,000	FRASCO 10 MILILITRO	24,80	49,60
Especificação: PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO					
54	SUGADOR	150,000	Pacote	10,14	1.521,00
Especificação: MATERIAL: PVC TIPO: SALIVA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ ARAME APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL					
55	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	1,000	Unidade	8,95	8,95
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM LARGURA: 4 MM APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL					
56	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	1,000	Unidade	8,74	8,74
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM LARGURA: 6 MM APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL					
57	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	1,000	EMBALAGEM 150 UNIDADE	10,95	10,95
Especificação: MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO COMPRIMENTO: CERCA DE 170 MM LARGURA: CERCA DE 4 MM TIPO USO: DESCARTÁVEL					
58	TIRA DE POLIÉSTER USO ODONTO	1,000	Pacote	5,08	5,08
Especificação: ESPECIFICAÇÃO: PARA AUXILIAR NA CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS; MEDIDA C.120MM (100 A 140 MM); L(9,5 A 11MM); ESP.0,05MM; CX C/ 50 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
59	VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE	1,000	Kit	23,00	23,00
Especificação: PARA PREVENÇÃO DA RECIDIVA E OCORRÊNCIA DE CÁRIES E FLUORETAÇÃO DO ESMALTE. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6% ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. E ETANOL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10 ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA					
60	CIMENTO ODONTOLÓGICO	2,000	Unidade	164,45	328,90
Especificação: TIPO: CIRÚRGICO PERIODONTAL CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM EUGENOL ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO					
61	ESCOVA DEGERMAÇÃO	200,000	Unidade	5,50	1.100,00
Especificação: APLICAÇÃO: COM PVP À 10% IODADO À 1%, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE COMPONENTES: C/ LIMPADOR DE UNHAS, BASE QUE PERMITA MANUSEIO A-					
62	ESPONJA COM AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTO	6,000	Caixa	50,00	300,00

gualde
@
P



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

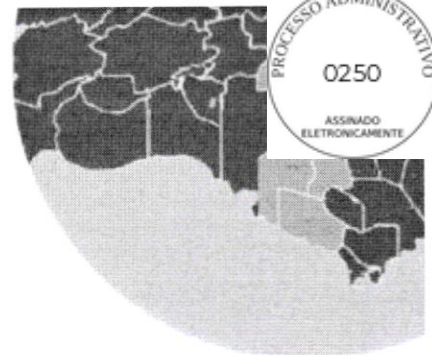


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: COMPOSTO DE COLAGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRACIAS, CAPILARES, POS OPERATORIO; AGENTE HEMOSTATICO COLAGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CUBICA, ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO, HEMOSTATICO E CICATRIZANTE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. C/10 UNID					
63	FITA PARA GLICOSÍMETRO	1,000	Caixa	74,81	74,81
Especificação: ESPECIFICAÇÃO: FITA PARA GLICEMIA – COPATIVEL COM APARELHO DA MARCA GLICOSÍMETRO (EM COMODATO) SENDO OAPARELHO COM 99% DE PRECISÃO, SIMPLES DE SE UTILIZAR, BASTA APENAS DUAS ETAPAS, TRAZ RESULTADOS RÁPIDOS PARA O USÁRIO EM 10 SEGUNDOS. APRESENTAÇÃO: UM MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, CHIP DE CODIFICAÇÃO, SOLUÇÃO CONTROLE, LANCETAS ESTEREIS, ESTOJO, DISPOSITIVO PARA LANCETAS, MANUAL DE INSTRUÇÃO. CAIXA C/100. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
64	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO 3-0	48,000	Caixa	45,00	2.160,00
Especificação: DE NYLON TRANCADA; COM DIAMETRO 03- 0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
65	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO 4-0	30,000	Caixa	45,00	1.350,00
Especificação: DE NYLON TRANCADA; COM DIAMETRO 04- 0, 45 CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
66	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 4-0	5,000	Caixa	165,00	825,00
Especificação: A SUTURA DE CATEGUTE CROMADO – FIO DE SUTURA É DO TIPO ABSORVÍVEL, DE ORIGEM ANIMAL, ESTÉRIL, COMPOSTA POR TECIDO CONECTIVO PURIFICADO, PRINCIPALMENTE COLÁGENO. DIÂM. FIO: 4-0; COMP. FIO: 75CM; TAM. AG.: 2,0CM; DESC. AG.: 1/2 CÍRC. CILIND.; COR: MARROM; CAIXA COM 24 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
67	FORMALDEÍDO (FORMOL)	2,000	Litro	18,69	37,38
Especificação: ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO CONCENTRAÇÃO: À 10% CARACTERISTICA ADICIONAL: EM SOLUÇÃO AQUOSA TAMPONADA					
68	KIT CIRÚRGICO DESCARTAVEL	2.000,000	Kit	33,00	66.000,00
Especificação: KIT DE CIRURGIA DESCARTAVEL ESTERIL CONTENDO: 02 TOALHAS DE MÃO; 02 GORROS DE LAÇO; 02 TOUCAS SANFONADAS; 02 AVENTAIS CIRÚRGICOS M/L; 03 MÁSCARAS TRIPLAS COM ELÁSTICO; 02 CAMPOS DE MESA 0,70 X 0,90M; 02 PROTETORES DE REFLETOR PP; 02 PROTETORES DE SUGADOR E MANGUEIRA 1,20 X 0,80M; 01 CAMPO CIRÚRGICO 2,00 X 0,90. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO DA DATA DE ENTREGA.					
69	SORO FISIOLÓGICO 0.9% ESTÉRIL	250,000	Frasco	5,26	1.315,00
Especificação: CLORETO DE SÓDIO DE 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 100 ML. SISTEMA FECHADO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
70	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 2%	6,000	Litro	22,00	132,00
Especificação: ANTISSEPTICO TÓPICO, ANTISEPSIA DA PELE NO PRÉ- OPERATÓRIO. O DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA É UM ANTISSEPTICO QUÍMICO, COM AÇÃO ANTIFÚNGICA E BACTERICIDA, CAPAZ DE ELIMINAR TANTO BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS QUANTO GRAM- NEGATIVAS. POSSUI TAMBÉM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, INIBINDO A PROLIFERAÇÃO BACTERIANA. É GERALMENTE UTILIZADO NA LIMPEZA DA PELE EM PRÉ- OPERATÓRIOS E TAMBÉM EM ALGUNS PEQUENOS PROCEDIMENTOS INVASIVOS COMO SUBSTITUTO A SOLUÇÕES CONTENDO IODO.					
71	SUGADOR CIRÚRGICO	48,000	Caixa	66,12	3.173,76
Especificação: PARA SANGUE, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 40 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					

3200
10
P



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

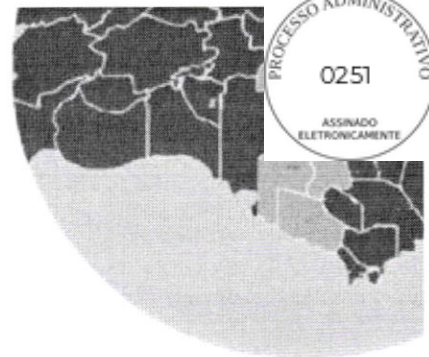

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0251
ASSINADO
ELETRONICAMENTE


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
72	ALGINATO CROMÁTICO TIPO I	250,000	Pacote	33,90	8.475,00
Especificação: PARA IMPRESSÃO, DE BAIXA SINÉRESE, COM CLOREXIDINA E LIVRE DE POEIRA, COM CARACTERÍSTICAS DE MUDAR DE COR DUAS VEZES, IDENTIFICANDO PRESA TOTAL E MOMENTO IDEAL PARA VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
73	CERA ODONTOLÓGICA	18,000	Unidade	20,40	367,20
Especificação: TIPO: 7 APRESENTAÇÃO: CAIXA 18 LÂMINAS PESO: CERCA DE 220 G COR: VERMELHA/ROSA					
74	CERA ODONTOLÓGICA	10,000	Unidade	25,60	256,00
Especificação: TIPO: 9 APRESENTAÇÃO: CAIXA 18 LÂMINAS PESO: CERCA DE 220 G COR: VERMELHA/ROSA					
75	CERA ODONTOLÓGICA	150,000	Unidade	26,60	3.990,00
Especificação: TIPO: PERIFÉRICA APRESENTAÇÃO: CAIXA 40 BASTÕES PESO: CERCA DE 45 G COR: VERMELHA/ROSA					
76	CERA ODONTOLÓGICA	6,000	Unidade	20,53	123,18
Especificação: TIPO: UTILIDADE APRESENTAÇÃO: CAIXA 5 LÂMINAS PESO: CERCA DE 220 G COR: VERMELHA/BRANCA					
77	CONDICIONADOR DE TECIDOS PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS MACIA	1,000	Kit	194,94	194,94
Especificação: KIT COM PÓ 170G E LÍQUIDO 177 ML. NA COR ROSA DE GENGIVA ARTIFICIAL. PODE SER PRENSADO NA CONFEÇÃO DA PRÓTESE. PODE SER REEMBASADO NA BOCA. PRECAUÇÕES: SOMENTE PARA USO - MACIO. REEMBASAMENTO DE PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS. CONFEÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL NOS MODELOS. PODE SER PRENSADO NA CONFEÇÃO DA PRÓTESE. PODE SER REEMBASADO NA BOCA. PRECAUÇÕES: SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO; LÍQUIDO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO: PÓ: POLÍMERO ACRÍLICO DE ETILMETACRILATO. LÍQUIDO: MONÔMERO ACRÍLICO ETILMETACRILATO, ÁLCOOL DESNATURADO E PLASTIFICANTE FTÁLICO. GLAZE: METILMETACRILATO E POLIMETILMETACRILATO. APRESENTAÇÃO: CADA KIT TEM: 1 FRASCO DE 40GR; 1 FRASCO DE 40 ML; 1 GLAZE 8 ML; 2 COPOS MEDIDORES; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
78	DISSOLVENTE DE GESSO	4,000	Frasco	49,32	197,28
Especificação: SOLVENTE DE GESSO DE 1 LITRO - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
79	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO USO ODONTOLÓGICO	5,000	Frasco	286,00	1.430,00
Especificação: APRESENTAÇÃO DE DUPLA COR COM 280 TIRAS DE 76X22MM E ESPESSURA DE 19 MICROMETROS; COMPOSTO POR PAPEIS ESPECIAIS, CERAS E ÓLEOS VEGETAIS, PIGMENTOS, PARAFINA E VASELINA. INDICADO PARA MARCAR CONTATOS OCLUSAIS. . PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
80	FIXADOR PARA PRÓTESE DENTÁRIA	12,000	Tubo	124,45	1.493,40
Especificação: SEM SABOR, EM CREME, SAL PARCIAL MISTO DE SÓDIO/CÁLCIO DE POLI (METILVINILÉTER/ÁCIDO MALEICO), CARBOXIMETILCELULOSE, ÓLEO MINERAL, VASELINA- TUBO 8,5G- QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ULTRA COREGA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
81	RESINA ACRÍLICA PÓ	2,000	Frasco	64,35	128,70
Especificação: INDICADO PARA REEMBASAMENTO, CONFEÇÃO COROAS CÔNICAS E TELESCÓPICAS; PRÓVISÓRIOS; INCRUSTAÇÕES, BARRAS LINGUAIS E PALATAIS; CONECTORES DE GRAMPOS; PONTES ADESIVAS; ALINHAMENTO DE JUNTAS A SEREM SOLDADAS; CONECTAR JUNTAS NO ENCERAMENTO DE PONTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM: PÓ COM 78G. INCOLOR.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA ENTREGA.					
82	RESINA ACRÍLICA LÍQUIDA	2,000	Frasco	44,10	88,20
Especificação: AUTOPOLIMERIZÁVEL, PRODUTO COMPOSTO DE ACETONA, ÁCIDO CIANÍDRICO E ÁLCOOL METÍLICO; EMBALAGEM: 120 ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA ENTREGA.					

81
82



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

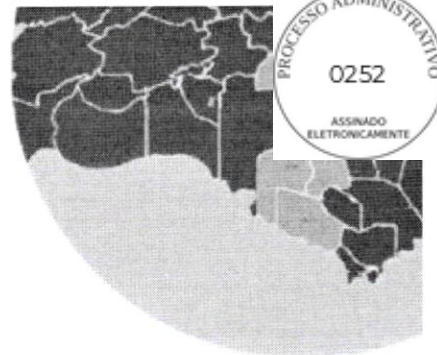

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
83	CESSO - USO ODONTOLÓGICO	200,000	EMBALAGEM 1 QUILOGRAMA	7,18	1.436,00
Especificação: TIPO: COMUM TIPO II					
84	CESSO - USO ODONTOLÓGICO	300,000	EMBALAGEM 1 QUILOGRAMA	33,20	9.960,00
Especificação: TIPO: PEDRA ESPECIAL TIPO IV					
85	PASTA MOLDAGEM	90,000	Unidade	53,32	4.798,80
Especificação: MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL TIPO: BASE + CATALISADOR APRESENTAÇÃO *: CONJUNTO COMPLETO QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À LYSANDA					
86	LÁPIS COPIA ESPECIAL PARA CESSO	1,000	Caixa	43,45	43,45
Especificação: LÁPIS PARA DELIMITAÇÃO DO MODELO. ESPECIAL PARA TRABALHOS EM GESSO. CONTEÚDO: CAIXA COM 12 LÁPIS. LÁPIS CÓPIA NA COR AZUL. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DADATA DE ENTREGA.					
87	VASELINA SÓLIDA	3,000	Frasco	21,00	63,00
Especificação: INDICAÇÕES: USO COMO EMOLIENTE.MODO DE USAR:USO TÓPICO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 90G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
88	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO	5,000	Unidade	17,95	89,75
Especificação: APLICAÇÃO: P/ ALGINATO TIPO: DOSADOR P/ PÓ MATERIAL: PLÁSTICO TIPO USO: REUTILIZÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORRESPONDENTE A MARCA DE ALGINATO ENTREGUE					
89	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	2,000	PACOTE 100 UNIDADE	13,19	26,38
Especificação: MATERIAL: LÁTEX NATURAL TIPO: EXTRAORAL DIÂMETRO: 1/2 POL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL TIPO FORÇA: FORÇA PESADA					
90	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	2,000	PACOTE 100 UNIDADE	13,34	26,68
Especificação: MATERIAL: LÁTEX NATURAL TIPO: EXTRAORAL DIÂMETRO: 1/2 POL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL TIPO FORÇA: FORÇA MÉDIA					
91	ELÁSTICO ORTODÔNTICO	2,000	PACOTE 100 UNIDADE	13,46	26,92
Especificação: MATERIAL: LÁTEX NATURAL TIPO: EXTRAORAL DIÂMETRO: 1/2 POL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL TIPO FORÇA: FORÇA LEVE					
92	CESSO BRANCO ORTODÔNTICO	50,000	Pacote	17,55	877,50
Especificação: É UM GESSO ALFA SUPER ALVO ESPECIAL PARA USO EM ORTODONTIA PELA EXCELENTE RESISTÊNCIA À FISSURA. SUA GRANULOMETRIA É FINA COM ACABAMENTO DE ALTO BRILHO. EMBALAGEM: PACOTE COM 2KG. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
93	EMBALAGEM ORTODONTIA	500,000	INIDADE	2,61	1.305,00
Especificação: MATERIAL: PLÁSTICO TIPO: CAIXA P/ APARELHO COM TAMPA E ALÇA					
94	ARCO EXTRAORAL MÉDIO DURO PEQUENO 51	2,000	Unidade	43,85	87,70
Especificação: INDICADO JUNTAMENTE COM VÁRIOS TIPOS DE CASQUETES E TALAS CERVICAIS PARA A OBTENÇÃO DE FORÇAS ORTODÔNTICAS OU ORTOPÉDICAS. OS ARCOS EXTRAORAIS SÃO CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL ESPECIAL, COM ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. VERSATILIDADE NO ÂNGULO DA APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
95	ARCO EXTRAORAL MÉDIO 50	2,000	Unidade	43,44	86,88

Handwritten notes:
Espec
10
P

Avenida Leão Sampaio, s/n CEP: 63.180-000 - Barbalha - CE

Telefone: (88) 3532-3386


cpsmjuaizerodonorte.ce.gov.br

@cpsm.jn

SESA




**SECRETARIA
DA SAÚDE**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

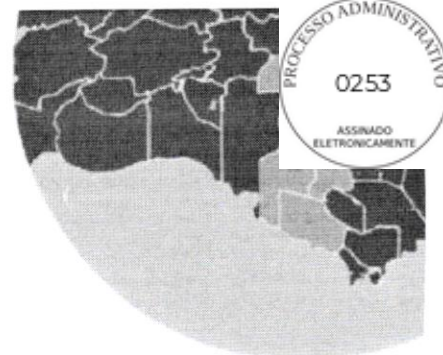

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: INDICADO JUNTAMENTE COM VÁRIOS TIPOS DE CASQUETES TALAS CERVICAIS PARA A OBTENÇÃO DE FORÇAS ORTODÔNTICAS OU ORTOPÉDICAS. OS ARCOS EXTRAORAIS SÃO CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL ESPECIAL, COM ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. VERSATILIDADE NO ÂNGULO DA APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
96	ACULHA DE IRRIGAÇÃO ENDODONTICAS ESTÉREIS	40,000	Caixa	57,22	2.288,80
Especificação: DE USO ÚNICO - BAIXO CUSTO, EMBALADAS UNITARIAMENTE. EVITA OS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO. DE DIMENSÃO 25 X 0,4 MM. CARACTERÍSTICAS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA USO ODONTOLÓGICO. ACULHA COM CANHÃO DE CONICIDADE 6% UNIVERSAL CONECTADO EM TODAS AS SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, FACILITANDO OS PROCEDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO. SEM BISEL (SEM PONTA) NÃO APRESENTA RISCO E DANOS AOS TECIDOS E ACIDENTES. APLICAÇÃO: PROJETADAS PARA AUXILIAR A LIMPEZA DAS RAÍZES E CANAIS. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
97	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO	2,000	Kit	33,50	67,00
Especificação: EMBALAGEM COM LÍQUIDO- FRASCO COM 15 ML. COMPOSIÇÃO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%, E PÓ FRASCO COM 38G. COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, POLIMETACRILATO DE METILA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
98	CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL	50,000	Kit	54,81	2.740,50
Especificação: PÓ E LÍQUIDO. APRESENTA BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS, RADIOPACIDADE E IMPERMEABILIDADE. POSSUI FINA GRANULAÇÃO, PROPORCIONANDO UMA MISTURA HOMOGÊNEA E UM PERFEITO ESCOAMENTO. APRESENTAÇÃO: 01 FRASCO COM 12G DE PÓ E 01 FRASCO COM 10 ML DE LÍQUIDO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
99	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	2,000	Kit	37,30	74,60
Especificação: COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL. INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE QUE NÃO INIBEM A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS AUTO OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS E APRESENTAM UMA COLORAÇÃO SEMELHANTE À DA DENTINA. KIT COM PASTA BASE (13G), PASTA CATALISADORA (11G) E BLOCO DE MISTURA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
100	CIMENTO OBTURADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	40,000	Kit	144,00	5.760,00
Especificação: OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL. APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE. APRESENTAÇÃO: KIT COM 1 FRASCO DE PÓ COM 8 GR E 1 BISNAGA DE RESINA COM 7,5 GR. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
101	CIMENTO REPARADOR	3,000	Caixa	429,55	1.288,65
Especificação: CIMENTO REPARADOR PARA COMPLICAÇÕES ENDODÔNTICAS - TRATAMENTO DE PERFURAÇÕES DE CANAL RADICULAR OU FURCA. SELAMENTO DE REABSORÇÕES INTERNAS E INTERNAS COMUNICANTES. RETROBTURAÇÃO EM CIRURGIAS PAREENDODÔNTICAS. CAPEAMENTO PULPAR EM TRATAMENTOS CONSERVADORES (PROTEÇÃO PULPAR DIRETA E PULPOTOMIA EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS). APEXIFICAÇÃO E APEXIGÊNESE. SELAMENTO INTRACORONÁRIO PRÉVIO AO CLAREAMENTO DENTAL INTERNO DE DENTES DESPULPADOS. SELAMENTO APICAL (PLUG) PARA OBTURAÇÃO RADICULAR EM CANAIS COM ABERTURA APICAL AMPLA. LIBERAÇÃO DE ÍONS CÁLCIO: AUXILIA NA RÁPIDA RECUPERAÇÃO ÓSSEA E FORMAÇÃO DO CIMENTO. MATERIAL ODONTOLÓGICO INDUTOR DE NEOFORMAÇÃO DE CIMENTO PERIRRADICULAR: VEDAMENTO BIOLÓGICO. HIDROFÍLICO: PERMITE UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE ÚMIDO SEM PERDA DE PROPRIEDADES. ALTA ALCALINIDADE: PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. BAIXA SOLUBILIDADE: NÃO PERMITE INFILTRAÇÃO MARGINAL. ÓXIDO DE CÁLCIO: PROMOVE A BIOCOMPATIBILIDADE TECIDUAL. AGREGADO DE ÓXIDOS: BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. ALTA RADIOPACIDADE: EXCELENTE VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA. TEMPO DE PRESA DE 15 MINUTOS; TEMPO DE PRESA FINAL REDUZIDO COMPARADO AOS SIMILARES. RENDIMENTO 07 PORÇÕES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					

esul
@
+



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
102	CONE ENDODÔNTICO	24,000	EMBALAGEM 120 UNIDADE	37,07	889,68
Especificação: TIPO: ABSORVENTE MATERIAL: PAPEL CALIBRE: 1ª SÉRIE COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SORTIDA ESTERILIDADE: ESTÉRIL					
103	CONE ENDODÔNTICO	12,000	EMBALAGEM 120 UNIDADE	40,35	484,20
Especificação: TIPO: ABSORVENTE MATERIAL: PAPEL CALIBRE: 2ª SÉRIE COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SORTIDA ESTERILIDADE: ESTÉRIL					
104	CONE ENDODÔNTICO	12,000	EMBALAGEM 120 UNIDADE	38,57	462,84
Especificação: TIPO: ACESSÓRIO MATERIAL: GUTA-PERCHA CALIBRE: PM(FM) COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS					
105	CONE ENDODÔNTICO	24,000	EMBALAGEM 120 UNIDADE	38,57	925,68
Especificação: TIPO: ACESSÓRIO MATERIAL: GUTA-PERCHA CALIBRE: M COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS					
106	CONE ENDODÔNTICO	24,000	EMBALAGEM 120 UNIDADE	32,95	790,80
Especificação: TIPO: ACESSÓRIO MATERIAL: GUTA-PERCHA CALIBRE: MF COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS					
107	ESPAÇADOR DIGITAL	2,000	Caixa	49,75	99,50
Especificação: CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESAÇÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "D". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR A DATA DE ENTREGA.					
108	ESPAÇADOR DIGITAL	2,000	Caixa	49,75	99,50
Especificação: CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESAÇÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "C". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR A DATA DE ENTREGA.					
109	EUCALIPTOL	2,000	Frasco	14,37	28,74
Especificação: USO ODONTOLÓGICO - LÍQUIDO INCOLOR; COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL U.S.P.; UTILIZADO CURATIVO TEMPORÁRIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE CONES; FRASCO COM 20ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
110	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO	2,000	FRASCO 10 MILILITRO	17,71	35,42
Especificação: COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL CONCENTRAÇÃO: 96%					
111	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO	8,000	Unidade	19,33	154,64
Especificação: COMPOSIÇÃO BÁSICA: METACRILATO ASPECTO FÍSICO: RESINA TIXOTRÓPICA TIPO USO: BARREIRA GENGIVAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOTOPOLIMERIZÁVEL					
112	HIDROXIDO DE CÁLCIO - PRO ANÁLISE	6,000	Unidade	9,04	54,24


raul

®


✂



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

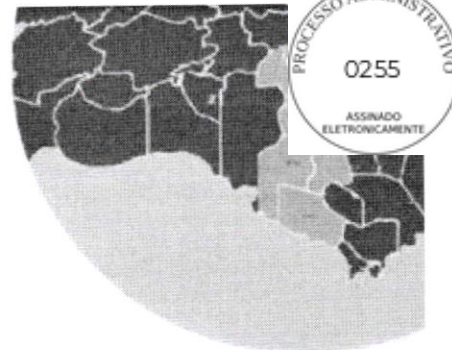

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: O HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CAPEADOR PULPAR, É UM DOS MATERIAIS MAIS ACEITOS ATUALMENTE PARA INDUZIR A FORMAÇÃO DA DENTINA REPARADORA, APRESENTANDO PROPRIEDADES IMPRESCINDÍVEIS PARA MATERIAIS QUE ATUAM EM PROCEDIMENTOS SOBRE A DENTINA. EMBALAGEM: FRASCO COM 10G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR A DATA DE ENTREGA.					
113	HIPOCLORITO DE SÓDIO	24,000	Litro	6,62	158,88
Especificação: ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRAÇÃO: ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO					
114	CLOREXIDINA AQUOSA 2%,	150,000	Litro	25,05	3.757,50
Especificação: SOLUÇÃO IRRIGADORA PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO, PROMOVE REDUÇÃO MICROBIANA					
115	MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA	120,000	EMBALAGEM 26 UNIDADE	29,26	3.511,20
Especificação: MATERIAL: LÁTEX NATURAL TIPO: LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO DIMENSÃO: CERCA DE 14 X 14 CM TIPO USO*: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL					
116	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM	24,000	Caixa	25,81	619,44
Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
117	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM-	8,000	Caixa	25,11	200,88
Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
118	LIMA KERR Nº 06, 25MM	8,000	Caixa	30,58	244,64
Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
119	LIMA KERR Nº 08, 21MM-	5,000	Caixa	28,63	143,15
Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO ACONTAR A DATA DE ENTREGA.					
120	LIMA KERR Nº 08, 25MM	12,000	Caixa	31,79	381,48




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
	Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS E RIGOROSA CONCENTRICIDADE AUTOCLAVÁVEL A 135° C PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS E QUÍMICOS CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA				
121	LIMA KERR Nº 10, 21MM	12,000	Caixa	28,45	341,40
	Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.				
122	LIMA KERR Nº 10, 25MM	24,000	Caixa	32,88	789,12
	Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.				
123	LIMA KERR SÉRIE Nº 15, 21MM-	6,000	Caixa	25,81	154,86
	Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.				
124	LIMA KERR Nº 15, 25 MM	24,000	Caixa	31,00	744,00
	Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.				
125	LIMA KERR Nº 20, 21MM	6,000	Caixa	27,05	162,30
	Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.				
126	LIMA KERR Nº 20, 25MM	24,000	Caixa	30,53	732,72

enrh
@
P



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

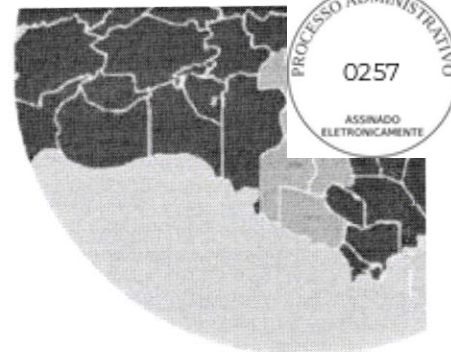


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304(COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM.INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA DO CANAL DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA. DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FISICO- RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA BACOMPANHANDO A CURVATURA					
127	LIMA KERR ESPECIAL Nº25, 21MM	6,000	Caixa	27,55	165,30
Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304(COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM.INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
128	LIMA KERR Nº25, 25MM	12,000	Caixa	28,40	340,80
Especificação: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 304(COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM.INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
129	LIMA RECIPROCANTE	24,000	Caixa	466,85	11.204,40
Especificação: LIMA PARA USO EM MOVIMENTO RECIPROCANTE (PROGRAMA WAVE ONE GOLD OU RECIPROC).LIMA 20/06: IDEAL PARA O 4º CANAL. LIMA 25/06: IDEAL PARA A MAIORIA DOS CASOS. LIMA 40/06: IDEAL PARA O CANAL PALATINO DE MOLARES SUPERIORES. EXCELENTEPODER DE CORTE E RESISTÊNCIA FLEXURAL. POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO DE SUPERFÍCIE BLUE COM CONTROLE DE MEMÓRIA (CM). SECÇÃOTRANSVERSAL TRIANGULAR. PONTA INATIVA. TAPER 06. 25MM. INDICADA PARA USO NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES (20.06/25.06/40.05)					
130	LIMA RECIPROCANTE COM TRATAMENTO TÉRMICO	12,000	Caixa	463,45	5.561,40
Especificação: LIMA RECIPROCANTE FABRICADO COM LIGA DE NITI COM TRATAMENTO TÉRMICO BLUE QUE GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA; SUAVE PROGRESSÃO DA LIMA NO CANAL; CONICIDADE DECRESCENTE NO MESMO INSTRUMENTO; PONTA INATIVA; PREPARA O CANAL RADICULAR PARA UM DIÂMETRO DE 0,25 MM COM UMA CONICIDADE DE 0,08 SOBRE OS PRIMEIROS MILÍMETROS APICAIS.QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A RECIPROC BLUE 25. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA					
131	LIMA RECIPROCANTE COM TRATAMENTO TÉRMICO	12,000	Caixa	463,45	5.561,40
Especificação: LIMA RECIPROCANTE FABRICADO COM LIGA DE NITI COM TRATAMENTO TÉRMICO BLUE QUE GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA; SUAVE PROGRESSÃO DA LIMA NO CANAL; CONICIDADE DECRESCENTE NO MESMO INSTRUMENTO; PONTA INATIVA; PREPARA O CANAL RADICULAR PARA UM DIÂMETRO DE 0,40 MM COM UMA CONICIDADE DE 0,06 SOBRE OS PRIMEIROS MILÍMETROS APICAIS.QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A RECIPROC BLUE 40. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA					
132	LIMA ROTATÓRIA	12,000	Caixa	133,06	1.596,72

emulh
®
✱



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

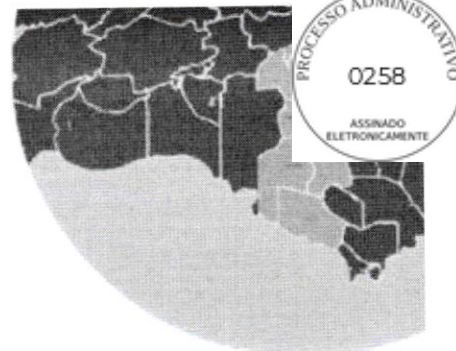


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: LIMA ROTATÓRIA UTILIZADA PARA O DESGASTE DO TERÇO CERVICAL DO CANAL RADICULAR, DESGASTANDO NO SENTIDO ANTI-CURVATURA. POSSUI PONTO 17 E TAPER 08, COM 19MM DE COMPRIMENTO. VELOCIDADE RECOMENDADA 350RPM E 2 N. TORQUE. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ORIFICE SHAPPER MKLIFE. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
133	LIMA USO ODONTOLÓGICO	2,000	CAIXA 6 UNIDADE	26,40	52,80
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: HEDSTROEM COMPRIMENTO: 21 MM APLICAÇÃO: DIGITAL TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40 COMPONENTES: C/ CURSOR APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO					
134	LIMA USO ODONTOLÓGICO	2,000	CAIXA 6 UNIDADE	26,40	52,80
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: HEDSTROEM COMPRIMENTO: 25 MM APLICAÇÃO: DIGITAL TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40 COMPONENTES: C/ CURSOR APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO					
135	LIMA USO ODONTOLÓGICO	2,000	CAIXA 6 UNIDADE	26,40	52,80
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: HEDSTROEM COMPRIMENTO: 21 MM APLICAÇÃO: DIGITAL TAMANHO: 2ª SÉRIE/45 A 80 COMPONENTES: C/ CURSOR APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO					
136	LIMA USO ODONTOLÓGICO	2,000	CAIXA 6 UNIDADE	26,40	52,80
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: HEDSTROEM COMPRIMENTO: 25 MM APLICAÇÃO: DIGITAL TAMANHO: 2ª SÉRIE/45 A 80 COMPONENTES: C/ CURSOR APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO					
137	EDTA USO ODONTOLÓGICO	6,000	Frasco	9,91	59,46
Especificação: COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ETILENO TETRACÉTICO / HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO APLICAÇÃO: AUXILIAR DE PREPARO DE CANAIS RADICULARES					
138	SOLUÇÃO OTÓPICA A BASE DE HIDROCORTISONA	6,000	Frasco	12,00	72,00
Especificação: SULFATO DE NEOMICINA E SULFATO DE POLIMIXINA B. SUSPENSÃO OTOLÓGICA HIDROCORTISONA 10 MG + SULFATO NEOMICINA 5MG, SULFATO DE POLIMIXINA 10.000 UI/ML. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
139	CURSOR ODONTOLÓGICO	2,000	CAIXA 100 UNIDADE	30,15	60,30
Especificação: MATERIAL: SILICONE TIPO USO: REUTILIZÁVEL ODOR: INODORO DIÂMETRO: 3 MM APLICAÇÃO: LIMA LIMPEZA CANAL RADICULAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, ESTERILIZÁVEL E COM ORIFÍCIO CENTRAL					
140	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO	6,000	FRASCO 200 MILILITRO	43,96	263,76
Especificação: APLICAÇÃO: TESTE DE VITALIDADE PULPAR APRESENTAÇÃO: AEROSOL TEMPERATURA: CERCA DE - 50°C					
141	TRICRESOL FORMALINA-	6,000	Unidade	12,52	75,12
Especificação: COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL E COMPOSTOS FENOLICOS. FRASCO COM 20 ML. PRODUTO COMVALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.					
142	CONE DE PAPEL ABSORVENTE F1, F2, F3	48,000	Caixa	94,05	4.514,40
Especificação: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES PREPARADOS POR SISTEMAS DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS/RECIPROCANTE, CORRESPONDENTE AOS SISTEMAS PROTAPER, TAMANHO F1, F2 E F3					
143	CONE GUTA PERCHA F1, F2, F3	96,000	Caixa	99,10	9.513,60
Especificação: INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAL DURANTE O TRATAMENTO COM OS SISTEMAS RECIPROCANTE COM DIÂMETRO DE PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTE AOS SISTEMAS PROTAPER. CAIXA COM 20 CONES DE GUTAPERCHA F1, 20 CONES DE GUTAPERCHA F2 E 20 CONES DE GUTAPERCHA F3.					



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

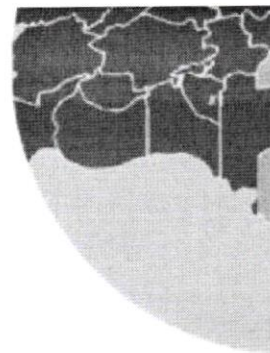

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
144	ARCO ODONTOLÓGICO	5,000	Unidade	8,00	40,00
Especificação: MATERIAL: PLÁSTICO TIPO: YOUNG TIPO USO: REUTILIZÁVEL FORMA: U APLICAÇÃO: ESTICAR LENÇOL BORRACHA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISOLAMENTO DENTAL					
145	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013	6,000	Unidade	4,62	27,72
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
146	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 HL	36,000	Unidade	4,16	149,76
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
147	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014	6,000	Unidade	4,55	27,30
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
148	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA	36,000	Unidade	4,28	154,08
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
149	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015	6,000	Unidade	4,62	27,72
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
150	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016	6,000	Unidade	4,00	24,00
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
151	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA	14,000	Unidade	4,00	56,00
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
152	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019	2,000	Unidade	4,55	9,10
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
153	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 FF	4,000	Unidade	4,00	16,00

📍 Avenida Leão Sampaio, s/n CEP: 63.180-000 - Barbalha-CE

☎ Telefone: (88) 3532-3386

🌐 cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br

📧 @cpsm.jn

SESA



**SECRETARIA
DA SAÚDE**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
154	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118 F	12,000	Unidade	4,00	48,00
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
155	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118 FF	12,000	Unidade	4,00	48,00
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
156	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195 F	4,000	Unidade	4,00	16,00
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
157	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195 FF	4,000	Unidade	4,00	16,00
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
158	BROCA ALTA ROTAÇÃO 4138	20,000	Unidade	5,35	107,00
Especificação: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
159	BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO	10,000	Unidade	37,68	376,80
Especificação: TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA, NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. SUA PONTA É INATIVA, APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO. O MODELO DE ALTA ROTAÇÃO POSSUI 21MM DE COMPRIMENTO E TENDO PARTE ATIVA DE 9MM. BLISTER CONTENDO 01 UNIDADE.; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
160	BROCA GATES Nº 2 DE 28 MM	4,000	Caixa	66,34	265,36
Especificação: (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
161	BROCA GATES Nº 3 DE 28MM	4,000	Caixa	65,00	260,00

Emenda

10


10




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: (DIÂMETRO 0,90), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
162	BROCA GATES Nº 4 DE 28 MM	4,000	Caixa	64,50	258,00
Especificação: (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
163	BROCA GATES Nº 5 DE 28 MM	4,000	Caixa	64,50	258,00
Especificação: (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
164	BROCA GATES Nº 6 DE 28MM	4,000	Caixa	58,74	234,96
Especificação: EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
165	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO NUMERO 700C HASTE LONGA	5,000	Unidade	21,05	105,25
Especificação: PARA ALTA ROTAÇÃO; AÇO CARBIDE; CÔNICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
166	BROCA ALTA ROTAÇÃO	5,000	Unidade	18,61	93,05
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: TRONCO CÔNICA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA TIPO HASTE: HASTE LONGA TIPO CORTE: CIRÚRGICA NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 701					
167	BROCA ALTA ROTAÇÃO	25,000	Unidade	18,61	465,25
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: TRONCO CÔNICA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA TIPO HASTE: HASTE LONGA TIPO CORTE: CIRÚRGICA NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 702					
168	BROCA ALTA ROTAÇÃO	5,000	Unidade	18,61	93,05
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: TRONCO CÔNICA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA TIPO HASTE: HASTE LONGA TIPO CORTE: CIRÚRGICA NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 703					
169	BROCA ODONTOLÓGICA CARBIDE TUNGSTENIO MINICUT	5,000	Unidade	79,50	397,50
Especificação: DE FORMA TRONCO CÔNICA. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO, AMERICAN BURNS NUMERO 1520 PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
170	BROCA ODONTOLÓGICA CARBIDE TUNGSTENIO MINICUT	2,000	Unidade	79,50	159,00




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

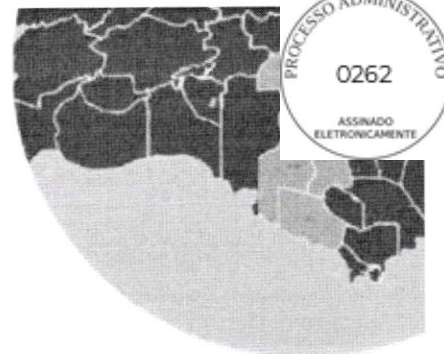

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: DE FORMA AGULHA CRUZADO FINO. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO, AMERICAN BURNS NUMERO 1511 PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
171	BROCA ODONTOLÓGICA CARBIDE TUNGSTENIO MINICUT	2,000	Unidade	79,50	159,00
Especificação: PERA CRUZADO FINO. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO, AMERICAN BURNS NUMERO 1517 PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PERA CRUZADO FINO 1517					
172	BROCA ODONTOLÓGICA CARBIDE TUNGSTENIO MIAXCUT	2,000	Unidade	83,00	166,00
Especificação: TRONCO CONICA. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO, AMERICAN BURNS NUMERO 1510 PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
173	BROCA ALTA ROTAÇÃO	4,000	Unidade	31,65	126,60
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: CILÍNDRICA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TRANSMETAL TIPO HASTE: 19 MM TIPO CORTE: CORTE GROSSO PONTA ATIVA: 12 MM DIÂMETRO					
174	BROCA ALTA ROTAÇÃO	4,000	Unidade	32,95	131,80
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: CILÍNDRICA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TRANSMETAL TIPO HASTE: 25 MM TIPO CORTE: CORTE GROSSO PONTA ATIVA: 12 MM DIÂMETRO					
175	BROCA ALTA ROTAÇÃO	2,000	Unidade	32,95	65,90
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: CÔNICA LONGA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO TIPO HASTE: HASTE REGULAR TIPO CORTE: ZEKRYA REFERÊNCIA: REF. 199					
176	BROCA ALTA ROTAÇÃO	2,000	Unidade	35,35	70,70
Especificação: MATERIAL: CARBIDE FORMATO: CÔNICA LONGA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO TIPO HASTE: HASTE LONGA TIPO CORTE: ZEKRYA REFERÊNCIA: REF. 199					
177	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	3,000	Unidade	16,45	49,35
Especificação: COM CORPO PLÁSTICO, CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
178	ESCOVA DE ROBSON	200,000	Unidade	1,76	352,00
Especificação: PARA CONTRA ÂNGULO - TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
179	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO	150,000	Unidade	1,97	295,50
Especificação: MATERIAL: SILICONE FORMATO: TAÇA COR: BRANCA APLICAÇÃO: PROFILAXIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL COMPATIBILIDADE: CONTRA ÂNGULO					
180	ETIQUETAS PARA ETIQUETADORA	120,000	Rolo	100,18	12.021,60
Especificação: COM TRÊS LINHAS -SISTEMA DE RASTREABILIDADE COM IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS E PACOTES ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM DUPLA CAMADA ADESIVA. DIMENSÃO: 27MM X 28MM EM ROLOS DE 500 ETIQUETAS. MÁQUINA ETIQUETADORA TRÊS LINHAS (EM CONTRATO DE COMODATO) - SISTEMA DE RASTREABILIDADE SENDO NÚMEROS E SÍMBOLOS COM CAPACIDADE PARA ROLOS COM 500 ETIQUETAS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
181	REFIL DE TINTA PARA ETIQUETADORA;	24,000	Unidade	224,50	5.388,00
Especificação: APRESENTAÇÃO ROLETE; COMPATÍVEL COM ETIQUETADORA BROWNE DE 3 LINHAS DE IMPRESSÃO					

3msh
®
✱



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
182	INDICADOR BIOLÓGICO	600,000	Unidade	2,61	1.566,00
Especificação: TIPO: TERCEIRA GERAÇÃO APRESENTAÇÃO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA ESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM 3 HORAS APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR					
183	INDICADOR QUÍMICO	2.500,000	Unidade	120,00	300.000,00
Especificação: CLASSE: CLASSE V TIPO USO: INTERNO TIPO: INTEGRADOR APRESENTAÇÃO: PÍLULA					
184	TESTE DE BOWIE & DICK (PACOTE PRONTO)	250,000	Pacote	16,00	4.000,00
Especificação: PARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ASSISTIDAS POR BOMBA DE VÁCUO. CONSTITUÍDO DE PAPEL COM TIRAS REAGENTES INSERIDOS EM PACOTES. ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO PARA PRONTO USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VICENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. APRESENTAÇÃO PCT. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
185	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO	16,000	Pacote	47,27	756,32
Especificação: DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTO-CONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
186	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 100 MTS	96,000	BOBINA TUBULAR	72,00	6.912,00
Especificação: COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FUIROS, RASCOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS,CORANTES,ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO,QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL,GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA,CONF.NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE,DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF.RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
187	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 MTS	48,000	BOBINA TUBULAR	105,60	5.068,80
Especificação: COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE UROS, RASCOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS,CORANTES,ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA,CONF.NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95% (BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE,DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF.RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
188	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100 MTS	36,000	BOBINA TUBULAR	144,00	5.184,00

Spick
@
J



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FURROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SÉRIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
189	PAPEL GRAU CIRURGICO 300 MM X 100 MTS	12,000	BOBINA TUBULAR	217,75	2.613,00
Especificação: COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FURROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SÉRIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 5%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
190	DESINFETANTE	30,000	Litro	28,80	864,00
Especificação: COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO PRINCÍPIO ATIVO: DIDECEILMETILAMÔNIO + BIGUANIDA + TENSOATIVOS TEOR ATIVO: TEOR ATIVO CERCA DE 0,1% FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA					
191	DETERGENTE ENZIMÁTICO NEUTRO	6,000	BOBONA 5 LITROS	160,00	960,00
Especificação: À BASE DE ENZIMA CELULASE, PROTEASE, LIPASE E AMILASE, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. INDICADO PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM GERAL, INSTRUMENTAIS MICROTUBULARES, PINÇAS DE BIÓPSIA E TODOS OS FIBROSCÓPIOS PARA QUALQUER ESPECIALIDADE MÉDICA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
192	MULTIENZIMATICO	12,000	BOBONA 5 LITROS	299,00	3.588,00
Especificação: DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1000 À 5.000 ML, DILUIÇÃO DE 2,0 ML POR LITRO, POUCO FORMACÃO DE ESPUMA, SEM ODORE AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR LAUDOS QUE COMPROVEM: ESTABILIDADE DAS ENZIMAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO, ESTABILIDADE DO SISTEMA CONSERVANTE, BIODEGRADABILIDADE, CORROSIVIDADE EM METAIS. OS LAUDOS DEVEM SER DE LABORATÓRIOS EXTERNOS. ACONDICIONAMENTO EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE. AS EMPRESAS DEVERÃO COTAR NA PROPOSTA O PREÇO DO LITRO DILUÍDO, PORÉM A ENTREGA SE FARÁ COM A SOLUÇÃO CONCENTRADA. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA E QUE ATENDA A NOVA RDC. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
193	DESINCROSTANTE LIQUIDO	2,000	Litro	54,99	109,98
Especificação: BASE ÁCIDO FOSFÓRICO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM ARTIGOS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. INDICAÇÃO: É INDICADO PARA DESINCROSTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DAR BRILHO EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHAS PROFISSIONAIS. PRODUTO CONCENTRADO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 LITRO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
194	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL	12,000	Unidade	207,38	2.488,56
Especificação: INDICADA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL: TESOURAS, PINÇAS HEMOSTÁTICAS E OUTROS. POSSUI 17,78 CM DE COMPRIMENTO, CERCAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES, SENDO QUE EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI TRÊS FILAS DE CERCAS PARA DESCONTAMINAÇÃO GERAL E, NA OUTRA EXTREMIDADE, CONTÉM UMA ÚNICA FILEIRA DE CERCAS PARA DESCONTAMINAÇÃO DELICADA E FINA. POSSUI CABO ANTIDERRAPANTE QUE FACILITA O USO. FORMATO DIVERSOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					

smult
@
f




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

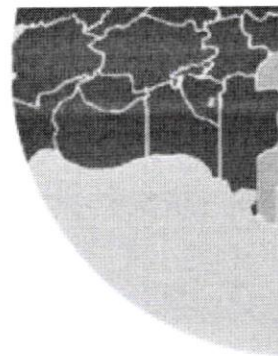

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
195	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE	24,000	Unidade	7,17	172,08
Especificação: MATERIAL: PAPELÃO CAPACIDADE TOTAL: 7 L ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE TIPO USO: DESCARTÁVEL					
196	SUPORE	2,000	Unidade	28,50	57,00
Especificação: MATERIAL: METAL APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLETOR DE 7 LITROS					
197	ESPELHO BUCAL	3,000	Caixa	54,66	163,98
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO TIPO: PLANO TAMANHO: Nº 3 USO: ENCAIXE UNIVERSAL TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 12 UNIDADES					
198	ESPELHO BUCAL	6,000	Caixa	74,04	444,24
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO TIPO: 1º PLANO TAMANHO: Nº 5 USO: ENCAIXE UNIVERSAL TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 12 UNIDADES					
199	CABO ESPELHO BUCAL	24,000	Unidade	6,85	164,40
Especificação: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FORMATO: OITAVADO TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL					
200	BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	4,000	Unidade	18,42	73,68
Especificação: DE TITÂNIO OU TUNGSTÊNIO, INDICADAS PARA O USO EM ESTRUTURAS DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
201	BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	4,000	Unidade	18,42	73,68
Especificação: DE TITÂNIO OU TUNGSTÊNIO, INDICADAS PARA O USO EM ESTRUTURAS DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
202	BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	4,000	Unidade	22,00	88,00
Especificação: DE TITÂNIO OU TUNGSTÊNIO, INDICADAS PARA O USO EM ESTRUTURAS DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
203	BROCA ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08	4,000	Unidade	15,85	63,40
Especificação: DE TITÂNIO OU TUNGSTÊNIO, INDICADAS PARA O USO EM ESTRUTURAS DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
204	CIMENTO ENDODÔNTICO	3,000	Caixa	110,63	331,89
Especificação: MATERIAL PARA PREENCHIMENTO DE CANAIS RADICULARES, À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E IODOFÓRMIO EM VEÍCULO VISCOSO, RADIOPACO, PRONTA PARA O USO PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
205	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO	3,000	Unidade	39,39	118,17
Especificação: COMPONENTE BÁSICO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO ASPECTO FÍSICO: PASTA APLICAÇÃO: ODONTOLÓGICA, RESTAURAÇÃO ENDODÔNTICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 TUBETE, CADA UM CONTENDO 2,7 G, MAIS UM TUBETE					

Endul
®
J



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
206	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL	24,000	Caixa	474,95	11.398,80
Especificação: REFORÇADO COM RESINA. APRESENTAÇÃO EM CÁPSULA, CAIXA COM 50 UNIDADES PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
207	RESINA COMPOSTA	12,000	SERINGA 4 GRAMA	318,55	3.822,60
Especificação: TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL " ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE					
208	RESINA COMPOSTA	12,000	SERINGA 2.5 GRAMA	18,58	222,96
Especificação: TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA ASPECTO FÍSICO: FLUIDA/FLOW A2					
209	MATRIZ ODONTOLÓGICA	1,000	CAIXA 64 UNIDADE	338,78	338,78
Especificação: MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA APLICAÇÃO: DENTES DECÍDUOS ANTERIORES E POSTERIORES FORMATO: COROAS COMPLETAS APRESENTAÇÃO: CONJUNTO SORTIDO TIPO USO: DESCARTÁVEL					
210	Alavanca Potts - Quinelato	12,000	Unidade	49,65	595,80
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável. * Direita					
211	Alavanca Potts - Quinelato	12,000	Unidade	49,65	595,80
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável. * Esquerda					
212	Alavanca Apexo - Quinelato	2,000	Unidade	48,00	96,00
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável. * Possui parte ativa serrilhada * 301					
213	Alavanca Apexo - Quinelato	2,000	Unidade	45,65	91,30
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável. * Possui parte ativa serrilhada, * 303					
214	Kit Alavanca Seldin Adulto com 3 unidades	12,000	Kit	133,90	1.606,80
Especificação: Jogo com 3 unidades. (1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta. Tamanho: 15 cm). Produto autoclavável. Possuem lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.					
215	Porta Agulha Com Videia 14 CM	12,000	Unidade	200,00	2.400,00
Especificação: Tipo De Alicates: Reta Comprimento:14 cm					
216	Tesoura Cirurgica Iris Reta 11,5cm - Quinelato	12,000	Unidade	20,42	245,04
Especificação: * Comprimento: 11,5 cm; * Reta; * Modelo Quinelato: Iris; * Código Quinelato: QT. 822.11; * Aço inoxidável; * Autoclavável.					
217	Tesoura Cirurgica Iris Curva 11,5cm - Quinelato	12,000	Unidade	21,00	252,00
Especificação: * Comprimento: 11,5 cm; * Curva; * Modelo Quinelato: Iris; * Código Quinelato: QT. 823.11; * Aço inoxidável; * Autoclavável.					
218	Pinça Mosquito Curva 12,5cm	2,000	Unidade	35,20	70,40
Especificação: * Totalmente autoclavável; * Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; * Validade: Indeterminada;					
219	Lima Seldin para Osso Nº 1 - Ref. QD.610.01 - Quinelato	10,000	Unidade	52,10	521,00
Especificação: * Aço Inox. * Autoclavável.					

Handwritten signature and initials.



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

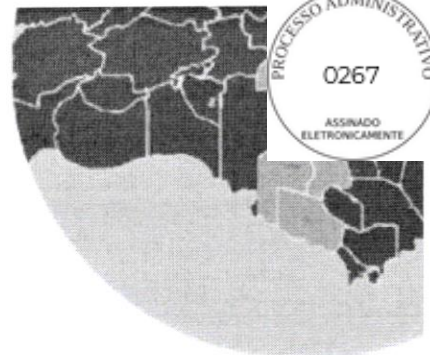

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
220	Cinzel Cirurgico Bi-Bizel	1,000	Unidade	29,55	29,55
Especificação: Material: aço inox, um material durável, resistente à corrosão e fácil de limpar; Acabamento: de ótima qualidade, que evita o acúmulo de sujeira e bactérias, e proporciona um aspecto brilhante e agradável ao instrumento; Pontas: afiadas e anguladas, que permitem cortar o tecido ósseo com precisão e facilidade, sem causar danos aos tecidos adjacentes; O produto possui duas pontas, uma em cada extremidade do instrumento, que podem ser usadas alternadamente ou simultaneamente, dependendo da necessidade do procedimento.					
221	Martelo Mead	1,000	Unidade	79,15	79,15
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável.					
222	Sonda Exploradora 47	30,000	Unidade	15,95	478,50
Especificação: A Sonda Exploradora 47 é uma ferramenta fundamental para profissionais da odontologia, especialmente em procedimentos de dentística e endodontia. Material: Aço Inoxidável AISI 420. Cabo: Oitavado. Autoclavável. Registro ANVISA: 10401319007.					
223	Tentacânula Odontologia	2,000	Unidade	17,74	35,48
Especificação: Com 15 cm de comprimento, este equipamento cirúrgico foi projetado para proporcionar suporte preciso e seguro durante os procedimentos, garantindo maior eficiência e segurança no consultório odontológico. Proteção dos tecidos adjacentes; Precisão cirúrgica; Apoio ao cirurgião; Durabilidade e resistência.					
224	Régua Endodôntica Milimetrada 35mm Plástica Autoclavável	5,000	Unidade	15,06	75,30
Especificação: · Esterilizável em estufa e autoclave. Leve: produzida em polímero de alta performance. · Garantia de qualidade. · Produzida em polímero de alta performance. Leve. · Resistente à ataque químico.					
225	Conjunto de Aspiração Endodôntico 1 Cânula + 3 Agulhas	15,000	Unidade	58,00	870,00
Especificação: A cânula com engate sem rosca facilita a higienização; Autoclavável; MEDIDAS DO PRODUTO: Agulha 4010: 49,1 mm x Ø 1,25mm. Agulha 4015: 49,2mm x Ø 1,50mm. Agulha 5020: 49,3mm x Ø 2,00mm. Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo).					
226	Grampo Para Isolamento Absoluto	20,000	Unidade	15,95	319,00
Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° 00: Indicado para pequenos pré-molares. Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização. Também são usados em odontopediatria.					
227	Grampo Para Isolamento Absoluto	15,000	Unidade	16,03	240,45
Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° 201: Indicado para molares superiores, com garras levemente arredondadas. As projeções das garras estão de acordo com a linha de curvatura da gengiva, proporcionando melhor estabilidade.					
228	Grampo Para Isolamento Absoluto	20,000	Unidade	17,71	354,20
Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° 26: Indicado para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento e dá mais estabilidade.					
229	Grampo Para Isolamento Absoluto	20,000	Unidade	17,35	347,00
Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° W8A: Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em molares decíduos.					
230	Grampo Para Isolamento Absoluto	20,000	Unidade	17,90	358,00

📍 Avenida Leão Sampaio, s/n CEP: 63.180-000 - Barbalha-CE

☎ Telefone: (88) 3532-3386


🌐 cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br

📧 @cpsmjn

SESA




SECRETARIA DA SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

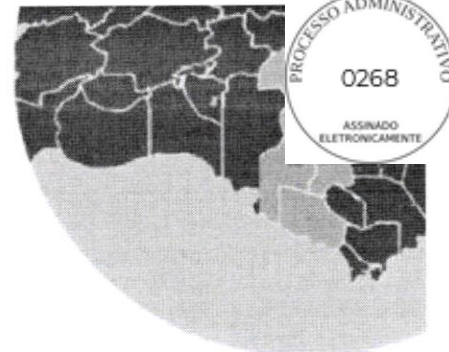

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° 209: Indicado para pequenos pré-molares inferiores. De garras planas e pequenas.					
231	Crampo Para Isolamento Absoluto	15,000	Unidade	19,40	291,00
Especificação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores inferiores e superiores. * N° 212: Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores.					
232	Pinça Clínica Para Algodão N° 317	20,000	Unidade	16,00	320,00
Especificação: Pertence à família de instrumental cirúrgico não articulado não cortante. Fabricado nos padrões de qualidade internacional. Pinça clínica também usualmente conhecida como Pinça para Algodão. Possui pino guia. Feita em aço inoxidável (Aço Inox AISI 420). É autoclavável. Garantia pelo fabricante: 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Registro ANVISA: 10401319007.					
233	Moldeira Total Perfurada Adulto Alumínio	3,000	Kit	150,98	452,94
Especificação: Material: Alumínio. Modelo: Adulto; Paciente Dentado. Autoclavável: Sim. Apresentação: Embalagem com 11 moldeiras (5 superiores: S1, S2, S3 s4 e S5; 4 inferiores: I1, I2, I3 I4 e I5; 1 giratória: 87). Categoria: Moldagem e Modelo, Moldeira para Moldagem. Registro ANVISA: 10409360002.					
234	Moldeira Total Perfurada de Plástico	10,000	Kit	16,00	160,00
Especificação: Tamanho 3 - Inferior/Superior Embalagem com 2 unidades (1 inferior e 1 superior). Modelo: Infantil Produto autoclavável, esterilização em autoclave até 134°C. Moldeira total, apresenta bordas arredondadas e lisas, canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais que aumentam a retenção do material. Moldeira plástica disponível na cor branca. Composição: nylon com fibra de vidro e pigmento branco. Armazenamento: nas embalagens para esterilização em local limpo, ao abrigo da luz solar direta e da umidade. Temperatura inferior a 30°C. Umidade inferior a 75 UR. Validade: indeterminada. Após aberto o produto possui validade de 50 ciclos de esterilização. Registro ANVISA: 80322400024.					
235	Moldeira Total Perfurada Adulto Alumínio Dentado	10,000	Unidade	12,51	125,10
Especificação: Embalagem com 1 unidade, para pacientes dentados. Tamanho: N° 2 Inferior Modelo: Perfurado. Uso: Para pacientes dentados. Cabo: Muito mais espesso para empunhadura segura e perfeita, com o mínimo de flexão na moldagem. Registro ANVISA: 10409360002.					
236	Moldeira Total Perfurada Adulto Alumínio Dentado	10,000	Unidade	12,12	121,20
Especificação: Embalagem com 1 unidade, para pacientes dentados. Tamanho: N° 2 Superior Modelo: Perfurado. Uso: Para pacientes dentados. Cabo: Muito mais espesso para empunhadura segura e perfeita, com o mínimo de flexão na moldagem. Registro ANVISA: 10409360002.					
237	Óculos De Proteção Epi Incolor Sobrepor Óculos De Grau	25,000	Unidade	8,44	211,00
Especificação: Materiais: Policarbonato Cor da lente: Incolor Tipo de tratamento da lente: Sobrepor					
238	Pontas Eletrodos De Baixa Para Bisturi Elétrico	2,000	Kit	343,50	687,00
Especificação: Kit de Eletrodos de Baixa para Bisturi Eletrônico Emai. Compatíveis com aparelho de Bisturi Eletrônico Odontológico Microprocessado BO 1300 MP Kit com 6 Eletrodos Autoclaváveis p/ Bisturi Acompanha: 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) Ref: EFR-67 1 Eletrodo tipo bola (2,1mm) Ref: EB-2.1 1 Eletrodo tipo bola (4,2mm) EB-4.2 1 Eletrodo tipo alça pequena (4,5mm) Ref: EAL-4.5 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) Ref:EA-85 1 Eletrodo tipo agulha depilação (66mm) Ref: EA-66.					
239	Motor Endodôntico	3,000	Unidade	6.321,53	18.964,59

Enviado
@
f


Avenida Leão Sampaio, s/n CEP: 63.180-000 - Barbalha - CE

Telefone: (88) 3532-3386

cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br

@cpsmjn

SESA SECRETARIA DA SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
Especificação: Motor Rotatório e Reciprocante c/programação de ângulo recíprocante de 10 em 10 graus; Leve, compacto, sem fio; Localizador integrado; Velocidade programável até 1000 RPM; Torque programável até 4N; Compatível com todos os sistemas de limas; Motor Rotatório e Reciprocante (esquerda e Direita); Torque (0,5 a 4N) e velocidade (de 120 a 1000 RPM); Auto-reverse, Auto-stop; Mini contra ângulo push-button; Programação Personalizada: Conta com programas personalizados, pré-programados para diferentes técnicas de endodontia. Garantia: 1 ano pelo fabricante Qualidade igual superior a marca Endopen - Schuster.					
240	Alicate Ortodôntico Weingart com Wídia	2,000	Unidade	385,43	770,86
Especificação: Possui pontas longas e finas e que possuem um serrilhado em sua parte interna. Pode ser empregado também para a inserção da presilha de uma barra transpalatina no tubo lingual e para a realização da dobra distal no extremo de um arco. Apresenta maior resistência e durabilidade, assegurando a apreensão de fios com maior segurança. Pontas ativas feitas em wídia (carboneto de tungstênio), material resistente livre de corrosão, que oferece precisão e durabilidade. Confeccionada em aço cirúrgico de alta qualidade. O processo para a reutilização do alicate envolve sete etapas básicas e fundamentais: desinfecção, limpeza prévia, enxágue, secagem, inspeção visual, embalagem e esterilização. Garantia pelo fabricante: 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA: 80328810069.					
241	Abridor de Boca Molt Infantil	2,000	Unidade	240,00	480,00
Especificação: * Embalagem com 1 unidade; * Tamanho: Infantil; * Fabricado em aço inox; * Autoclavável. * Não Cortante. * Tamanho: 11 cm.					
242	Alicate Ortodôntico 139	5,000	Unidade	122,95	614,75
Especificação: * Aço inox. * Autoclavável.					
243	CONDICIONADOR DENTAL	12,000	Pacote	8,17	98,04
Especificação: TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO CONCENTRAÇÃO: 37% ASPECTO FÍSICO: GEL SERINGA 2,5 MILITRO					
244	ADESIVO DENTAL	12,000	Frasco	48,90	586,80
Especificação: TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL COMPONENTES: MONOCOMPONENTE FRASCO 4 MILILITRO					

Deste modo, como tendo como parâmetro as pesquisas de preços realizadas, tem-se que o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta de R\$ 705.359,85 (setecentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)


8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Neste Estudo Técnico Preliminar, a decisão pelo parcelamento da solução para a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos tem como objetivo otimizar a competitividade e a eficiência econômica, atendendo às diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021.

- Avaliação da Divisibilidade do Objeto:
 - O objeto da licitação, composto de diversos materiais e equipamentos odontológicos, é tecnicamente divisível, permitindo o parcelamento sem comprometer a funcionalidade ou os resultados esperados.
- Viabilidade Técnica e Econômica:
 - O parcelamento do objeto é técnica e economicamente viável. A divisão permite manter a qualidade e a eficácia dos materiais e equipamentos a serem adquiridos, alinhando-se com as melhores práticas do setor.
- Economia de Escala:



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

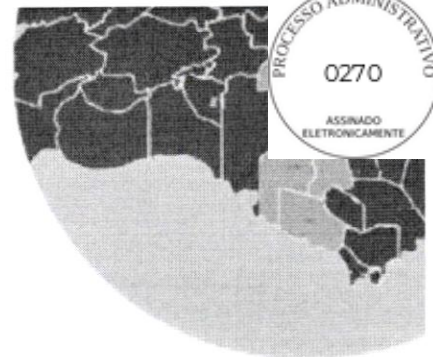

- A decisão pelo parcelamento foi tomada com a consideração de não comprometer a economia de escala. O parcelamento está desenhado para evitar aumentos desproporcionais nos custos, garantindo que os benefícios da escalabilidade sejam mantidos.
- Competitividade e Aproveitamento do Mercado:
 - O parcelamento incentivará uma maior competitividade e permitirá um melhor aproveitamento do mercado, possibilitando a participação de um número maior de fornecedores, incluindo pequenos empreendedores.
- Análise do Mercado:
 - A decisão pelo parcelamento está alinhada às práticas correntes do mercado de bens odontológicos, confirmando que esta abordagem é adequada e se alinha com as expectativas e capacidades dos fornecedores do setor.
- Consideração de Lotes:
 - A contratação será dividida em lotes, sempre que possível e aplicável, para facilitar a participação de fornecedores que não tenham capacidade de atender à totalidade do contrato sem comprometer a economia de escala.

Esta abordagem garante conformidade com as normativas vigentes, assegurando um processo transparente e fundamentado pelos princípios da eficiência e economicidade.


9. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Este processo de contratação para registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos odontológicos está plenamente alinhado com o Plano de Contratação Anual da entidade, conforme demonstrado pelos seguintes aspectos:

- A contratação encontra-se prevista no Plano de Contratação Anual registrado sob o número 11436747000103-0-000001/2025, que assegura a adequação das ações de aquisição de materiais e equipamentos às necessidades estimadas para o exercício financeiro de 2025.
- O processo de contratação considera a previsão orçamentária estabelecida para o exercício de 2025, garantindo que os recursos disponíveis sejam utilizados de maneira eficiente e em conformidade com as disposições orçamentárias.
- Este alinhamento com o planejamento anual permite atender à demanda prevista do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Ticiano Van Den Brule Matos, assegurando assim a continuidade e a qualidade dos serviços odontológicos prestados à população da Microrregião de Juazeiro do Norte.
- Além disso, a contratação está em conformidade com as diretrizes estratégicas da entidade, promovendo um planejamento integrado e a gestão adequada dos recursos destinados à saúde odontológica.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual, exercício de , conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 11436747000103-0-000001/2025



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte



Data de publicação no PNCP: 27/12/2024

ID do item no PCA	Classe/Grupo
-------------------	--------------

10. Resultados pretendidos

Com a presente contratação de registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, almejam-se os seguintes resultados:


- **Continuidade dos Serviços:** Assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços odontológicos especializados prestados à população pela instituição durante o exercício de 2025.
- **Eficiência na Aquisição:** Obter os materiais e equipamentos com base nas melhores práticas de mercado, respeitando os princípios da economicidade e eficiência previstos na Lei 14.133/2021.
- **Qualidade e Compatibilidade:** Garantir que os produtos adquiridos atendam às especificações técnicas normativas exigidas, assegurando qualidade e compatibilidade técnica com os sistemas existentes no Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Ticiano Van Den Brule Matos.
- **Otimização de Recursos:** Maximizar o aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, de forma alinhada com o planejamento estratégico e orçamentário do consórcio.
- **Desenvolvimento Nacional Sustentável:** Incentivar e promover práticas que contribuam para o desenvolvimento nacional sustentável, conforme disposto na legislação aplicável.

11. Providências a serem adotadas

As seguintes providências deverão ser adotadas para garantir o sucesso do processo de registro de preços para a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos:


- 1. Treinamento de Equipe:
 - Capacitar servidores para atuar na fiscalização e gestão do contrato.
 - Oferecer treinamentos específicos relacionados ao uso e manutenção dos equipamentos odontológicos adquiridos.
- 2. Articulação e Planejamento:
 - Conferir o alinhamento da contratação com o Plano de Contratação Anual e as disposições orçamentárias de 2025.
 - Estabelecer cronograma para o processo licitatório, incluindo etapas de análise de propostas e homologação.
- 3. Comunicação e Divulgação:
 - Divulgar todos os documentos pertinentes do processo licitatório em plataformas oficiais, respeitando as normas de transparência da Lei n.º 14.133/2021.

canal
@
P



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

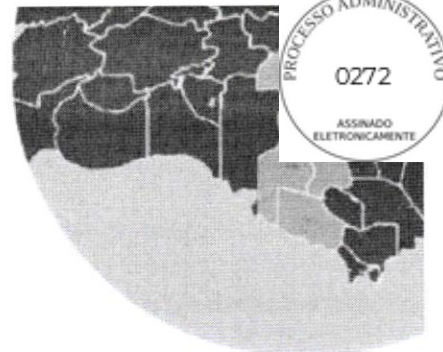


- Promover a ampla participação de fornecedores através de notificações de intenção de registro de preço.
- 4. Controle e Monitoramento:
 - Implementar procedimentos de controle para monitorar o andamento do processo e a execução do contrato.
 - Realizar auditorias periódicas para garantir a conformidade com os termos do contrato e as práticas administrativas.
- 5. Avaliação de Impacto:
 - Comparar os preços registrados com os valores de mercado para assegurar a economicidade da contratação.
 - Analisar os resultados da contratação em termos de custo-benefício e atendimento das necessidades do centro odontológico.

12. Justificativa para adoção do registro de preços

A adoção do sistema de registro de preços para a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para o Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Ticiano Van Den Brule Matos justifica-se por diversos fatores, conforme as disposições da Lei 14.133/2021:


- **Atendimento a Necessidades Variáveis:** A demanda por materiais e equipamentos odontológicos não é constante, variando de acordo com as necessidades dos atendimentos e procedimentos realizados ao longo do ano. O registro de preços permite flexibilidade na aquisição apenas das quantidades necessárias em momentos específicos, minimizando excessos e desperdícios.
- **Economia de Escala e Condições Comerciais Favoráveis:** O art. 82 da Lei 14.133/2021 prevê a possibilidade de economia de escala, permitindo a negociação de quantidades maiores que resultam em melhores condições comerciais. Contratar por meio de registro de preços pode proporcionar condições mais vantajosas que aquisições individuais.
- **Otimização da Gestão de Contratos:** O sistema de registro de preços reduz a necessidade de múltiplos processos licitatórios ao longo do ano, facilitando a gestão e o controle dos contratos e permitindo uma supervisão mais eficiente dos fornecedores, reduzindo custos administrativos.
- **Flexibilidade e Celeridade no Atendimento:** Conforme estabelece o art. 83 da Lei 14.133/2021, a existência de preços registrados implica compromisso de fornecimento, porém, não obriga a Administração a contratar imediatamente, permitindo flexibilidade para adquirir os materiais apenas quando necessário, atendendo com celeridade as demandas imediatas do Centro.
- **Prevenção contra Descontinuidade de Atendimento:** O art. 86 da mesma lei destaca a possibilidade de adesões por órgãos ou entidades da Administração Pública em situações de desabastecimento, o que é fundamental para prevenir qualquer interrupção nos serviços de saúde odontológica oferecidos à população.

Dessa forma, o sistema de registro de preços se apresenta como a solução mais



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

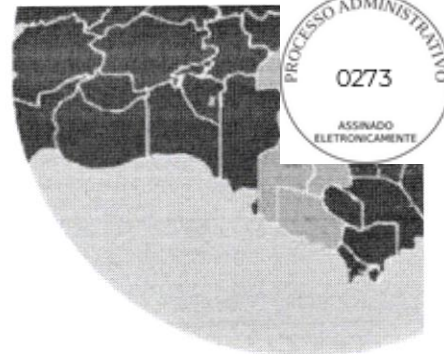

eficiente e vantajosa para atender à demanda prevista, garantindo o melhor uso dos recursos públicos e a continuidade da oferta de serviços de saúde odontológica de qualidade pelo Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Ticiano Van Den Brule Matos.

13. Da vedação da participação de empresas na forma de consórcio

Com base na Lei nº 14.133/2021, destacam-se as seguintes fundamentações para a vedação da participação de empresas na forma de consórcio no presente processo licitatório:


- A Lei 14.133 permite, em seu Art. 15, a participação de empresas em consórcio, no entanto, o mesmo artigo estabelece que tal permissão deve ser criteriosa e depender de justificativa técnica das vantagens que tal formação pode trazer. No contexto do presente processo licitatório, as características dos materiais e equipamentos odontológicos não demandam tal arranjo, uma vez que não há complexidade técnica que justifique a agregação de empresas para execução do objeto.
- A ausência de complexidade técnica e a padronização dos materiais e equipamentos odontológicos a serem adquiridos tornam desnecessária a formação de consórcios, que poderia acarretar em aumento desnecessário de custos administrativos e dificuldades na gestão e fiscalização dos contratos, contrariando os princípios da eficiência e economicidade estabelecidos no Art. 5º da Lei 14.133.
- A participação isolada de empresas propicia maior concorrência e igualdade de condições entre os licitantes, o que está alinhado ao Art. 11, que visa assegurar tratamento isonômico e evitar concentrações de mercado que possam prejudicar a justa competição.
- Considerando o cenário de mercado atual para materiais e equipamentos odontológicos, existem fornecedores qualificados individualmente tanto da perspectiva técnica quanto econômica, eliminando a necessidade ou vantagem na formação de consórcios.
- Assim, a vedação à participação em consórcio neste processo não representa uma limitação à concorrência, mas uma medida cautelar para assegurar uma licitação mais competitiva e eficiente, atendendo ao interesse público.

14. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

Com base na Lei 14.133, a avaliação de possíveis impactos ambientais relacionados à aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para o Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Ticiano Van Den Brule Matos foi conduzida de forma a assegurar o cumprimento dos princípios do desenvolvimento nacional sustentável e da economicidade.



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

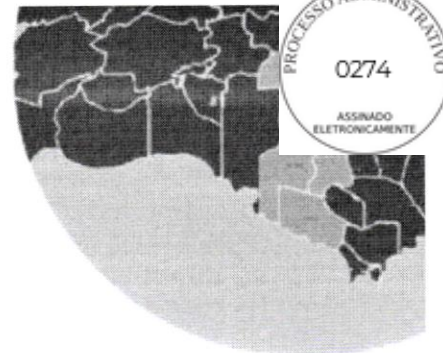

- A adoção de requisitos de baixo consumo de energia e de recursos naturais nos equipamentos a serem adquiridos.
- Implementação de sistemas de logística reversa para o desfazimento responsável e reciclável dos produtos e embalagens, reduzindo o impacto ambiental e incentivando práticas sustentáveis.
- A exigência, nos editais, de certificações ambientais relevantes, como ISO 14001, para garantir que os fornecedores adotem práticas sustentáveis em seus processos produtivos.
- Promoção do uso de materiais recicláveis e biodegradáveis sempre que possível, conforme estabelecido pelo Art. 26 da Lei 14.133, incentivando a utilização de bens e matérias-primas que minimizem os efeitos sobre o meio ambiente.
- Incentivo à inovação tecnológica que resulte em práticas mais verdes e eficientes, conforme previsto no planejamento da licitação, para a seleção de propostas que contemplem soluções que promovam menos desperdício.
- Elaboração de um plano de contingência para a gestão de resíduos gerados pela atividade odontológica, em conformidade com as normas ambientais vigentes.


Essas medidas foram delineadas de acordo com as orientações e objetivos traçados pela referida lei, visando não apenas a conformidade legal, mas também a responsabilidade ambiental do processo de contratação pública.

15. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

Após a análise detalhada do contexto e das necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Ticiano Van Den Brule Matos, concluímos que a contratação de materiais e equipamentos odontológicos por meio do registro de preços é viável e razoável. Fundamentamos nossa conclusão com base na Lei 14.133/2021, que delineia estruturas eficientes para planejamento e execução de licitações, destacando os seguintes pontos:


- A contratação está em conformidade com o planejamento estratégico e as diretrizes orçamentárias do consórcio de saúde, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados (Art. 18, §1º, I e II).
- O registro de preços proporciona flexibilidade e economicidade, permitindo compras escalonadas conforme demanda, o que está alinhado com os princípios de economicidade e eficiência da Lei (Art. 5º e Art. 40, II).
- A previsão de especificações técnicas rigorosas assegura que os materiais e equipamentos adquiridos atenderão aos padrões de qualidade e segurança exigidos pela legislação nacional, conforme ANVISA e ABNT, conforme descrito nos requisitos da contratação (Art. 18, §1º, III).
- O levantamento de mercado realizado indica que há múltiplos fornecedores com capacidade de atender à demanda prevista, promovendo a competitividade e o desenvolvimento sustentável, favorecendo a obtenção de melhores preços e condições (Art. 18, §1º, V e Art. 11, I e IV).

Estudo
©
f



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

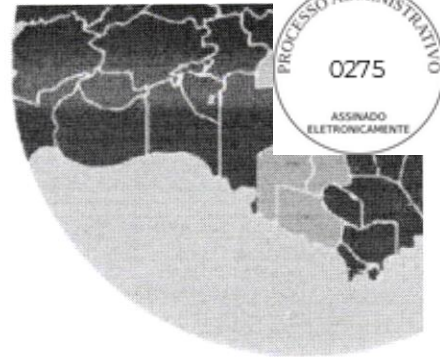

- Medidas de gestão de riscos foram consideradas para mitigar qualquer impacto ambiental associado ao ciclo de vida dos produtos, conforme diretrizes especificadas na lei para compras públicas sustentáveis (Art. 18, §1º, XII).
- Por fim, a proposta de contratação através do sistema de registro de preços é considerada a mais vantajosa para a Administração Pública, promovendo a melhor aplicação dos recursos disponíveis e atendendo ao interesse público primário de assegurar serviços odontológicos de qualidade para a população da Microrregião de Juazeiro do Norte (Art. 11, I e III).

Portanto, recomendamos seguir com o processo de licitação, adotando o sistema de registro de preços para a aquisição dos materiais e equipamentos odontológicos necessários para o exercício de 2025.

Juazeiro do Norte / CE, 18 de fevereiro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Esther Viana de Oliveira
assinado eletronicamente

Esther Viana de Oliveira
PRESIDENTE

Hebert Pereira Soares
assinado eletronicamente

Hebert Pereira Soares
MEMBRO

Juliana Rodrigues Monteiro da Silva
assinado eletronicamente

Juliana Rodrigues Monteiro da Silva
MEMBRO